CONSIGNES D'INSTALLATION

Forest DENTALEZ

LÉGENDE DES SYMBOLES D'ALERTE Les avis de sécurité associés aux éléments suivants doivent faire l'objet d'une attention particulière lorsqu'ils apparaissent dans les procédures d'entretien, d'utilisation et d'urgence du guide.

⚠ *ATTENTION indique que la sécurité personnelle du patient, de l'utilisateur final ou du technicien pourrait être compromise si l'avis d'ATTENTION n'est pas respecté. Le non-respect des consignes peut entraîner une blessure.*

⚠ *AVERTISSEMENT indique qu'une procédure ou une précaution particulière doit être suivie pour éviter toute irrégularité du système ou tout dommage éventuel au produit.*

❗ *REMARQUE indique des informations spéciales destinées à faciliter l'entretien du produit ou à clarifier des informations importantes.*

DISPOSITIF MAINS-LIBRES D'ASPIRATION À HAUTE VÉLOCITÉ

ÉTAPE 1 : Faites glisser l'appuie-tête vers le haut jusqu'à ce qu'il soit dégagé du fauteuil (FIG. 1).

ÉTAPE 2 : Insérez la barre de glissement de l'appuie-tête dans la fente de montage (FIG. 2).

ÉTAPE 3 : Positionnez l'assemblage en haut de la barre, au ras de la fente de dégagement (FIG. 3).

ÉTAPE 4 : Positionnez l'appuie-tête comme vous le souhaitez et serrez à la main la vis de serrage pour le fixer. Passez à la page 2.

⚠ *ATTENTION : Lorsque vous travaillez avec un crachoir et/ou des fluides drainés ou aspirés dans un récipient, il est recommandé de porter un équipement de protection individuelle (EPI) pour éviter toute exposition à d'éventuels déchets dangereux.*

⚠ *ATTENTION : Avant de commencer, assurez-vous que le collecteur de solides, si le système en est doté, est vide. Si ce n'est pas le cas, avec des gants, retirez la crépine jetable du récipient directement dans un sac étanche pour éviter de renverser le contenu contaminé.*

❗ *REMARQUE : Vérification de l'installation : Consultez le Guide de l'opérateur et effectuez toutes les opérations. Si les opérations se déroulent comme prévu, terminez l'installation. Si les opérations ne se déroulent pas comme prévu, passez en revue les étapes des CONSIGNES D'INSTALLATION pour vérifier l'installation ou appelez le service d'assistance technique au 800-423-3555.*

FIG. 1 :

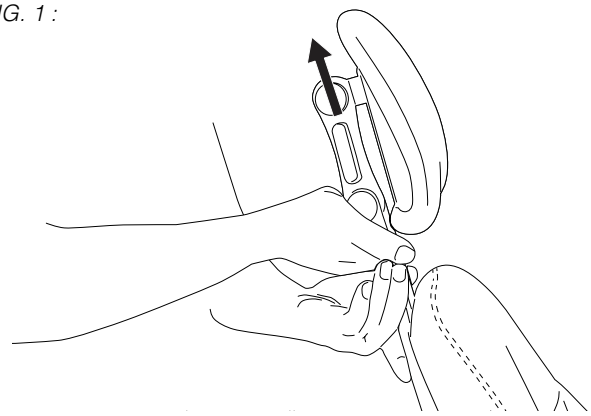

FIG. 2 :

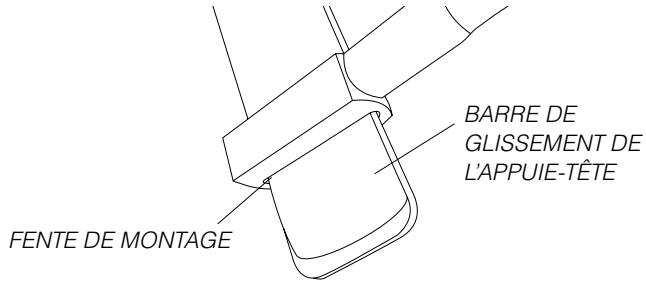

FIG. 3 :

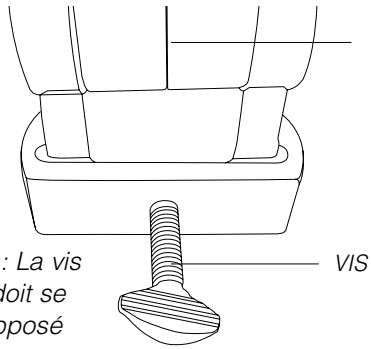

⚠ *ATTENTION : La vis de serrage doit se trouver à l'opposé du patient.*

ÉTAPE 5 : Clipsez la buse d'aspiration à haute vélocité dans le support ; le bras flexible de l'assistant se disposera derrière le fauteuil (FIG. 4-4.1).

REMARQUE : Si le modèle existant d'aspiration à haute vélocité n'est pas compatible avec le support, remplacez le tuyau par celui qui est fourni.

ÉTAPE 6 : Fixez le tuyau d'aspiration à haute vélocité au port prévu à cet effet (FIG. 5).

REMARQUE : L'illustration du récipient d'aspiration peut ne pas représenter le modèle dont est équipé votre bloc opératoire. Consultez votre Guide de l'opérateur pour identifier l'emplacement et le raccordement appropriés pour le tuyau. L'installation du tuyau d'aspiration à haute vélocité peut nécessiter le retrait d'un capuchon ou du tuyau existant.

FIG. 4 :

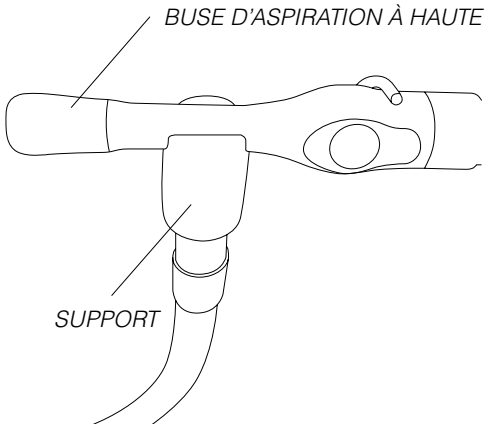

FIG. 4.1 :

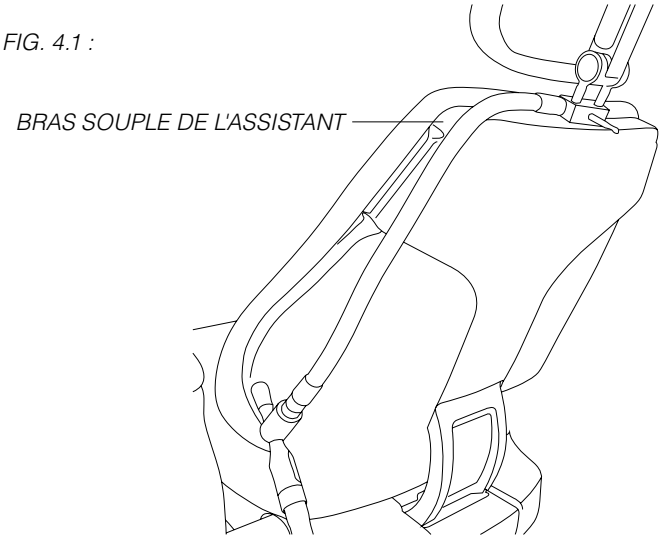

FIG. 5 :

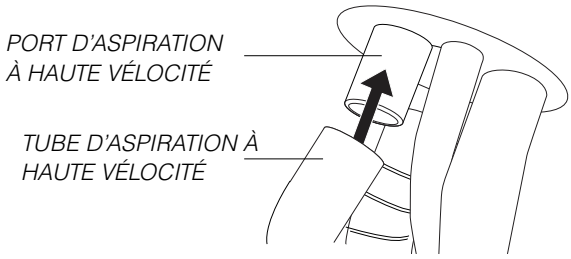

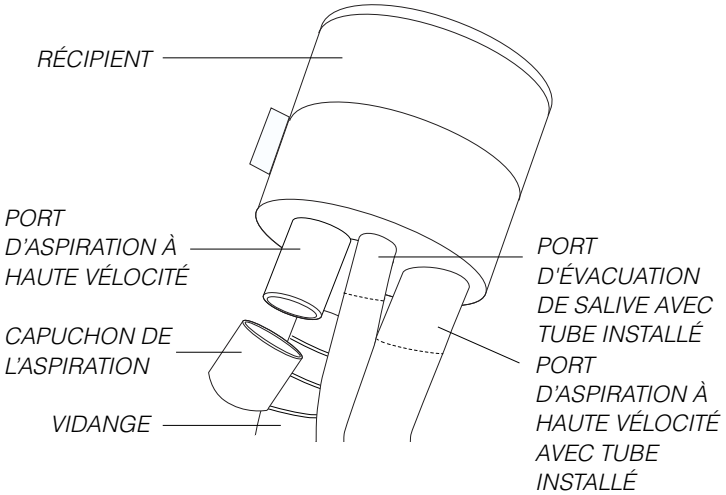

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 États-Unis (NG) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715