NUR ASSISTENT INTERNATIONAL

SCHRITT 1: Montieren Sie den Arm des internationalen Assistenten unter den Stuhladapter, indem Sie das Diagramm des Lagersatzes verwenden (ABB. 1).

0010-680 DIAGRAMM LAGERSATZ

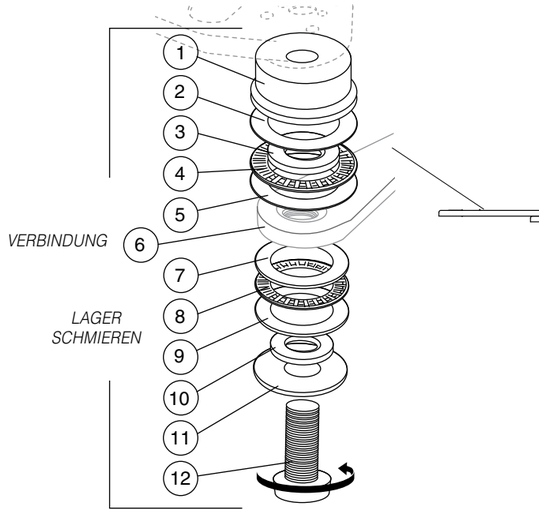

ABB. 1:

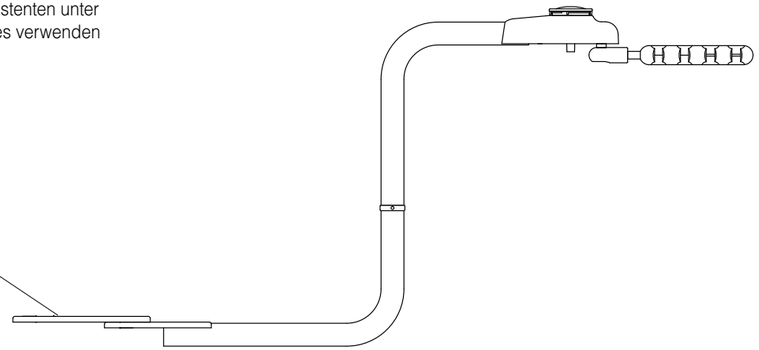

INSTALLATION DES MUNDSPÜLBECKENS

SCHRITT 1: Installieren Sie ggf. das Mundspülbecken mit Buchse in der Sidebox (ABB. 1-1.2).

SCHRITT 2: Verlegen und verbinden Sie den Ablassschlauch (ABB. 1.2).

ABB. 1: DELUXE

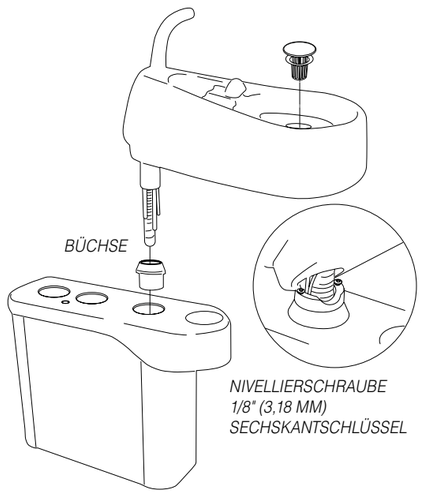

ABB. 1.2: GRUNDLEGENDES

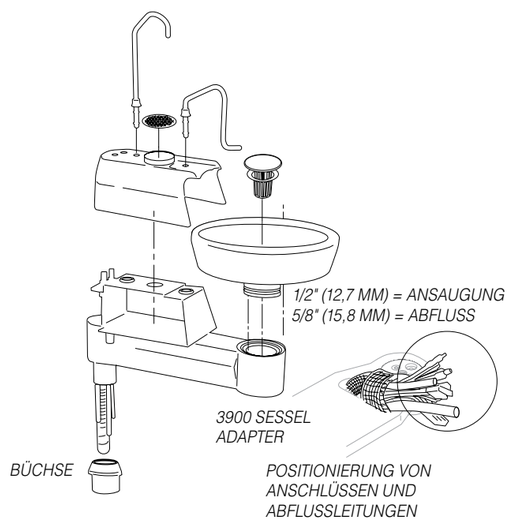

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

FESTE STUHLHALTERUNG MIT SIDEBOX (INTERNES VERSORGUNGSKABEL)

Forest DENTALEZ

MONTAGEAN-LEITUNG

WARNSYMBOL-TASTE

Die folgenden Sicherheitshinweise sollten besonders beachtet werden, wenn sie in den Wartungs-, Betriebs- und Notfallverfahren des Handbuchs erscheinen.

⚠ *WARNUNG weist darauf hin, dass die persönliche Sicherheit des Patienten, des Endbenutzers oder des Technikers bei Nichtbeachtung der WARNUNG gefährdet sein könnte. Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen.*

⚠ *VORSICHT weist darauf hin, dass ein bestimmtes Verfahren oder eine Vorsichtsmaßnahme befolgt werden muss, um Unregelmäßigkeiten im System oder mögliche Schäden am Produkt zu vermeiden.*

ℹ *HINWEIS kennzeichnet besondere Informationen, die die Wartung des Produkts erleichtern oder wichtige Informationen verdeutlichen.*

⚠ *VORSICHT: Um Schäden durch elektrostatische Entladungen (ESD) an der Elektronik zu vermeiden, tragen Sie immer ein geerdetes Handgelenkband, das mit einem Erdungsadapter (z. B. Bananen- oder Erdungsstecker) verbunden ist, wenn Sie mit Leiterplatten, Stuhlsteuerungen und Kabeln hantieren oder im Bereich elektrischer Schaltungen arbeiten.*

⚠ *VORSICHT: Änderungen vor Ort, die die elektrische und/oder mechanische Sicherheit von Forest™-Produkten beeinträchtigen, stehen im Widerspruch zu den Anforderungen der Agentur für Bauunterlagen und werden von Forest nicht genehmigt.*

ℹ *HINWEIS: Überprüfung der Installation: Lesen Sie die Bedienungsanleitung und führen Sie alle Schritte aus. Wenn der Betrieb wie vorgesehen funktioniert, ist die Installation abgeschlossen. Wenn der Betrieb nicht wie vorgesehen funktioniert, überprüfen Sie die Schritte in der INSTALLATIONSANLEITUNG, um die korrekte Installation zu bestätigen, oder rufen Sie den technischen Kundendienst unter 800-423-3555 an.*

INSTALLATION DES STUHLADAPTERS

SCHRITT 1: Schließen Sie den Stuhl an das Stromnetz an.

SCHRITT 2: Heben Sie das Basis und die Rückenlehne des Stuhls vollständig in die obere Position.

SCHRITT 3: Trennen Sie den Stuhl vom Stromnetz.

ℹ *HINWEIS: Lassen Sie die Installation des Stuhladapters und die Installation des Versorgungskabels für den Stuhl aus, wenn der Stuhl bereits verschlaucht ist.*

SCHRITT 1: Positionieren Sie den Stuhladapter so, dass die Stuhlkante unter der Unterlegscheibenkante zu liegen kommt. Die Befestigung hält sich selbst in Position (ABB. 1).

SCHRITT 2: Schieben Sie die Unterlegscheibe auf die Stuhlkante (ABB. 2).

SCHRITT 3: Bringen Sie den 15/16" (23,81 mm)-Befestigungsbolzen locker an der Rückseite der Befestigung und im Stuhl an (ABB. 3).

SCHRITT 4: Legen Sie eine Wasserwaage auf den Stuhladapter, parallel und senkrecht zur Mittellinie des Stuhls.

SCHRITT 5: Stellen Sie sicher, dass der Stuhladapter waagerecht ist.

ℹ *HINWEIS: Wenn eine Nivellierung erforderlich ist, stellen Sie die 3/16-Zoll (4,76 mm)-Stellschrauben (3) ein, bis der Stuhladapter des Geräts waagerecht ist.*

SCHRITT 6: Ziehen Sie den 15/16" (23,81 mm)-Befestigungsbolzen (55 Fuß-Pfund (74,57 Nm)) an (ABB. 4).

ℹ *HINWEIS: Überprüfen Sie die Schritte 4, 5 und 6, nachdem das Gerät und die Leuchte installiert sind. Bei Bedarf erneut nivellieren.*

ABB. 1:

ABB. 2:

ABB. 3:

ABB. 4:

STUHL VERSORGUNGSKABEL INSTALLATION

SCHRITT 1: Führen Sie die Versorgungsleitung zwischen dem Magnetverteiler und dem Hydraulikflüssigkeitsbehälter (ABB. 1).

SCHRITT 2: Führen Sie das Versorgungskabel nach oben in den Liftrahmen (ABB. 2).

SCHRITT 3: Führen Sie das Versorgungskabel durch die Versorgungskabelführungen (ABB. 3).

SCHRITT 4: Führen Sie das Versorgungskabel durch die Rückenlehne des Stuhls nach oben in die Sitzschale (ABB. 4).

SCHRITT 5: Führen Sie das Versorgungskabel aus dem Stuhlgehäuse nach oben in den Stuhladapter (ABB. 5).

SCHRITT 6: Führen Sie das Versorgungskabel durch die untere Öffnung des Stuhladapters. Führen Sie das Kabel durch den Nabelschlitz nach oben und wieder heraus (ABB. 6).

INSTALLATION DES SIDEBOX-LIEFERSYSTEMS

SCHRITT 1: Mit einem 1/8" (3,18 mm)-Sechskantschlüssel die Seitenabdeckung der Sidebox entfernen (ABB. 1).

SCHRITT 2: Die Sidebox auf den Stuhladapter über die Nivellierbuchse setzen.

SCHRITT 3: Stecken Sie den Steuer-/Lichtpfosten in die Nivellierfassung.

SCHRITT 4: Richten Sie den Pfosten mit einer Wasserwaage aus und stellen Sie die Nivellierschrauben mit einem 5/32" (3,97 mm)-Inbusschlüssel entsprechend ein.

SCHRITT 5: Schieben Sie den Dekorationskragen über den Pfosten (ABB. 2).

SCHRITT 6: Operationsleuchte in die Lichtsäule montieren. Führen Sie den Kabelbaum durch das Säulenloch in der Sidebox und wieder heraus (ABB. 3).

ABB. 1:

ABB. 2:

ABB. 3:

ABB. 4:



ABB. 5:

ABB. 6:

ABB. 1:

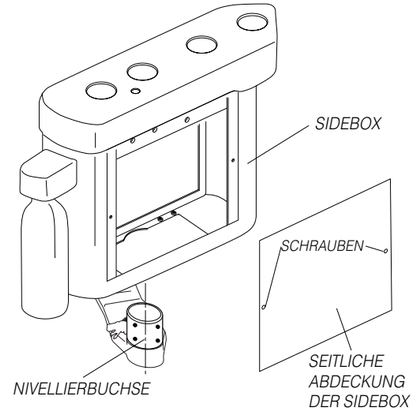

ABB. 2:

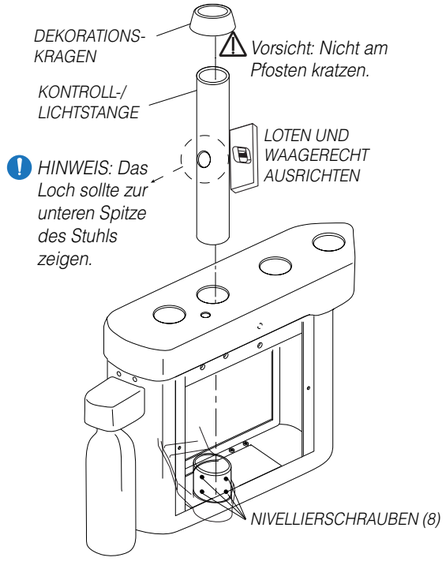

ABB. 3:

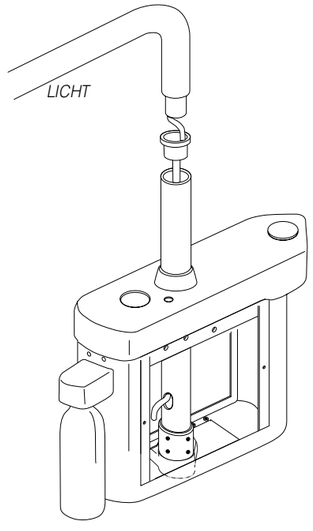

INSTALLATION DES SIDEBOX-LIEFERSYSTEMS (FORTGESETZT)

SCHRITT 7: Führen Sie den Lieferarm des Arztes und die Versorgungsleitung in die Sidebox ein (ABB. 4).

SCHRITT 8: Verbinden Sie die Versorgungsschläuche, die Saugschläuche, die Kabelanschlüsse und den Beleuchtungskabelstrang mit dem Versorgungskabel des Stuhls (ABB. 5).

SCHRITT 9: Entfernen Sie die Endkappe und stellen Sie die Spannung des Flexarms so ein, dass das Gleichgewicht des Arztkontrollkopfes erhalten bleibt. Endkappe wieder anbringen (ABB. 6).

HINWEIS: Bei richtiger Einstellung hält die interne Flexarmfeder das Gewicht des Steuerkopfes zurück, wenn der Hauptschalter in der Aus-Stellung ist.

INSTALLATION DES ASSISTENTEN

SCHRITT 1: Bringen Sie den Teleskoparmstift im 1/2" (12,7 mm)-Loch an und hängen Sie die HVE, SE und Spritze in die Halterung (ABB. 7).

HINWEIS: Für internationale Bestellungen, siehe Seite 4.

SCHRITT 2: Fahren Sie ggf. mit Mundspülbecken auf Seite 4 fort.

ABB. 4:

ABB. 5:

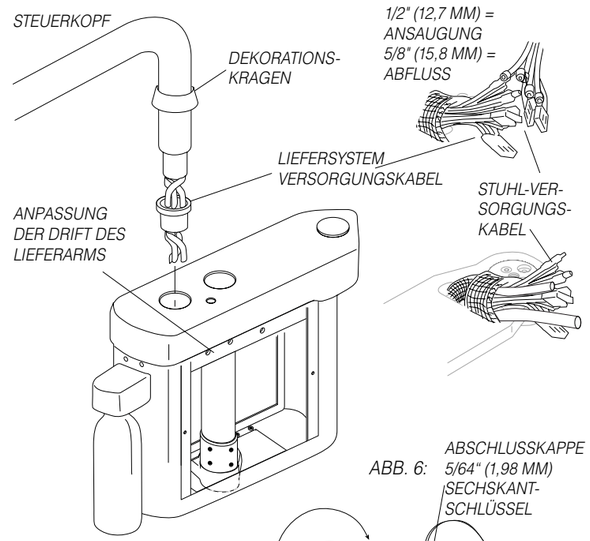

ABB. 6:

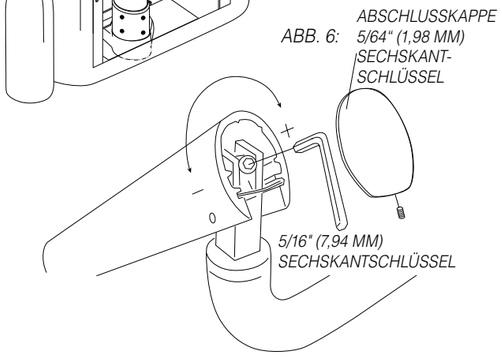
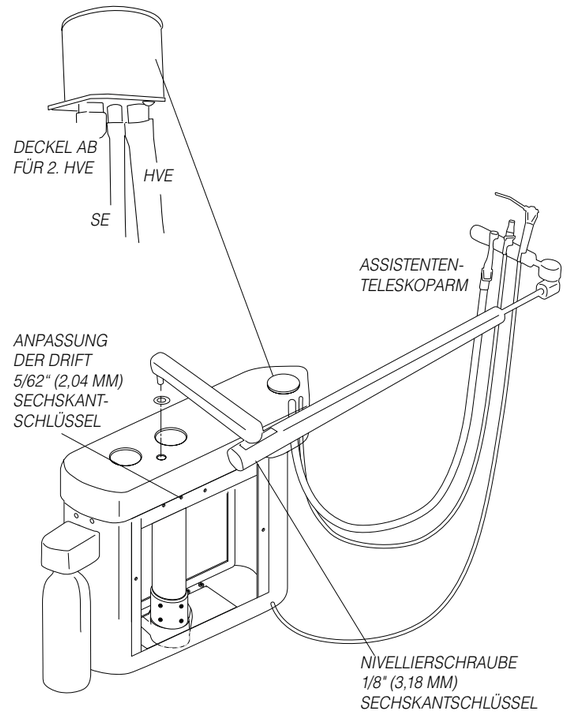
ABB. 7: