# Forest

DENTALEZ

Ein Glossar mit Symbolen und Begriffen, eine Erklärung zur EMV/ elektrischen Sicherheit und Hinweise für den Benutzer finden Sie im Forest™-Benutzerhandbuch mit allgemeinen Informationen.

*INDIKATIONEN FÜR DEN GEBRAUCH/VERWENDUNGSZWECK* Die Monitorhalterung ist eine Halterung für einen Monitorbildschirm, der die Mundhöhle vergrößert oder visualisiert, um eine bessere Sicht auf einen zahnärztlichen Patienten zu ermöglichen, wenn er zusammen mit einer intraoralen Kamera von einem Zahnarzt während der diagnostischen und therapeutischen Behandlung in einer klinischen Umgebung verwendet wird. Es gibt keine Kontraindikationen für dieses Produkt.

*ERWARTETE NUTZUNGSDAUER* Bei ordnungsgemäßer Wartung und Instandhaltung sind Forest Produkte für eine definierte "Lebensdauer" bei normalem Gebrauch (basierend auf ca. 50 Patienten pro Woche) von 5 Jahren ab Herstellungsdatum ausgelegt, mit Ausnahme der zu wartenden Komponenten. Einige Komponenten können aufgrund von technologischen Veränderungen oder Produktverbesserungen veraltet sein und Produktaktualisierungen oder Upgrades erforderlich machen. Nach Ablauf der festgelegten Nutzungsdauer müssen alle Produkte vor der weiteren Verwendung durch einen geschulten Servicetechniker überprüft werden. Danach sind alle 5 Jahre weitere Untersuchungen erforderlich.

⚠ *WARNUNG: Der Monitor (Flachbildschirm) muss auf eine 100 x 100 VESA-Platte passen und darf dies nicht überschreiten: Gewicht: 15 lbs (6.81 kg) Diagonale Gesamtgröße: 24" (61,96 cm).*

⚠ *VORSICHT: Nach Bundesrecht darf dieses Gerät nur von einem Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes verkauft werden, der nach dem Recht des Staates, in dem er praktiziert, berechtigt ist, das Gerät zu verwenden oder seine Verwendung anzuordnen.*

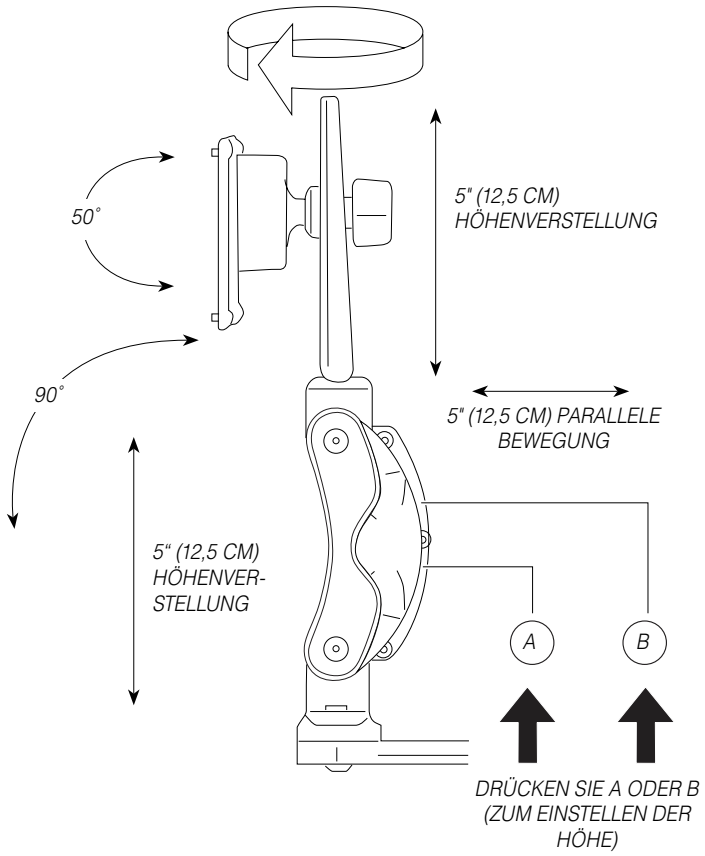


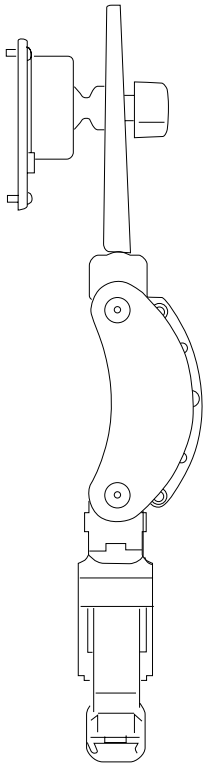

*DTE OREGON, INC.* *DENTALEZ.COM*

*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715*

CE