Forest DENTALEZ

LEYENDA DE SÍMBOLOS DE ALERTA Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

❗ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

EYECTOR DE GRAN VOLUMEN MANOS LIBRES

PASO 1: Deslice el reposacabezas hacia arriba hasta sacarlo del sillón (FIG. 1).

PASO 2: Inserte la barra de deslizamiento del reposacabezas en la ranura de montura (FIG. 2).

PASO 3: Posicione la montura en la parte superior del deslizador al ras de la ranura de altura (FIG. 3).

PASO 4: Posicione el reposacabezas a la altura deseada y ajuste el tornillo de tensión manualmente para fijarlo. Pase a la página 2.

⚠ *ADVERTENCIA: Al trabajar con una salivera y/o fluidos de succión/drenaje de lata, se recomienda el uso de equipos de protección personal "PPE", por sus siglas en inglés, para evitar la exposición a posibles desechos peligrosos.*

⚠ *ADVERTENCIA: Antes de comenzar, asegúrese de que la lata colectora de sólidos, si es que hay una, esté vacía. Si no lo está, usando guantes, retire el filtro descartable de la lata y colóquelo directamente en una bolsa a prueba de pérdidas para evitar derramar contenidos contaminados.*

❗ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

FIG. 1:

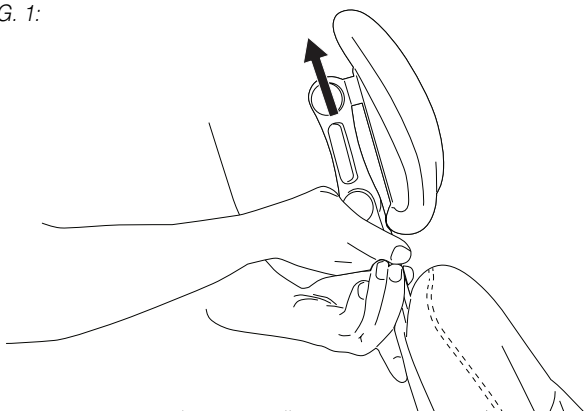

FIG. 2:

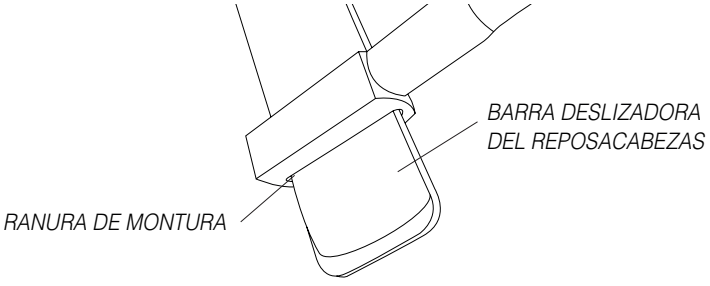

FIG. 3:

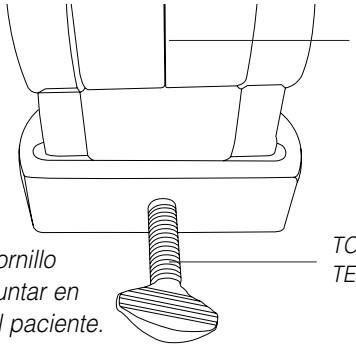

⚠ *ADVERTENCIA: El tornillo de tensión debe apuntar en dirección opuesta al paciente.*

PASO 5: Colocar la boquilla en el soporte presionando hasta que quede fija en su lugar; el brazo de asistente flexible quedará acomodado detrás del sillón (FIG. 4-4.1).

NOTA: Si el estilo de eyector de gran volumen existente no es compatible con el soporte, reemplace el conjunto de manguera del eyector de gran volumen por el provisto.

PASO 6: Conectar el tubo del eyector de gran volumen al puerto para el eyector (FIG. 5).

NOTA: La ilustración de la lata de vacío podría no representar el estilo utilizado en su consultorio. Consulte su Guía del Usuario para identificar la ubicación y conexión adecuada de los tubos. La instalación de los tubos del eyector de gran volumen podría requerir el retiro de una tapa del eyector o un tubo del eyector existente.

FIG. 4:

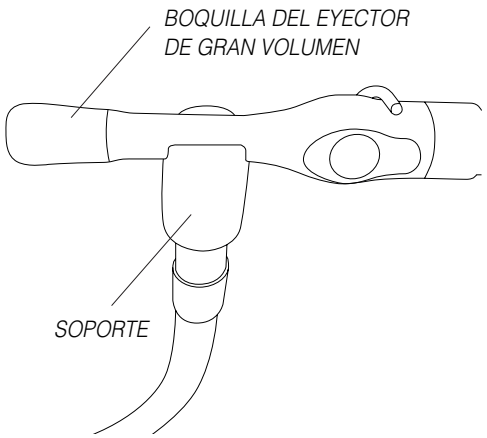

FIG. 4.1:

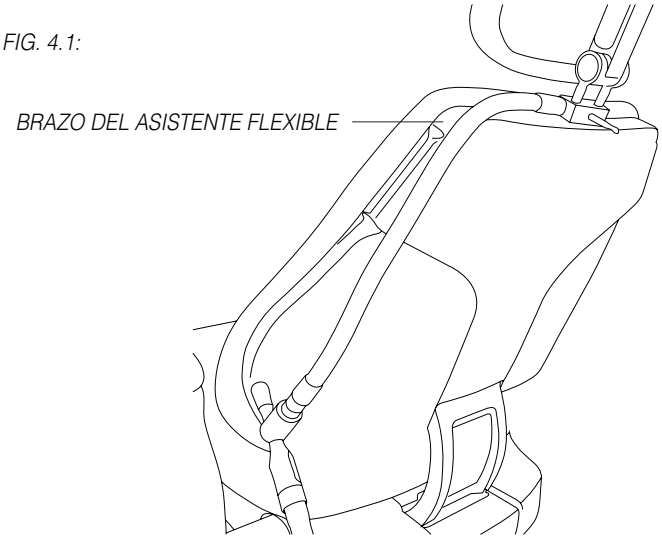

FIG. 5:

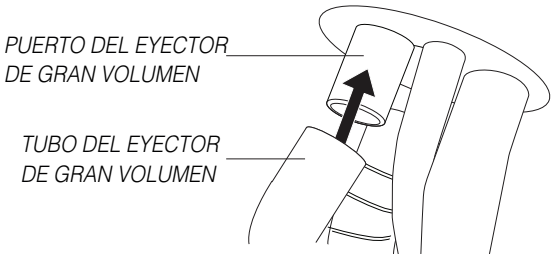

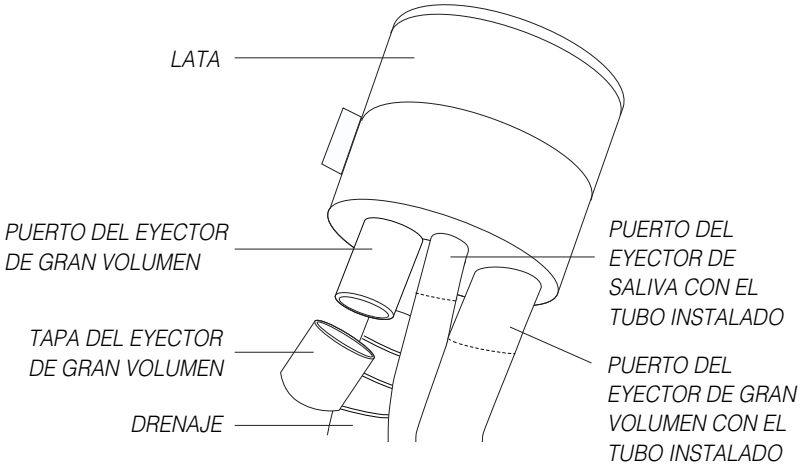

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715