BRACCIO FLESSIBILE AEROSOL DELL'ASSISTENTE CON EVACUATORE AD ALTO VOLUME (HVE)

Forest DENTALEZ

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni può provocare lesioni.

ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o possibili danni al prodotto.

NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti.

EVACUATORE AD ALTO VOLUME (HVE) A MANI LIBERE

PASSO 1: Far scorrere il poggiatesta verso l'alto fino a staccarlo dalla poltrona (FIG. 1).

PASSO 2: Inserire la barra di scorrimento del poggiatesta attraverso la fessura di montaggio (FIG. 2).

PASSO 3: Posizionare il supporto sulla sommità della barra di scorrimento a filo con la fessura di tolleranza (FIG. 3).

PASSO 4: Posizionare il poggiatesta come desiderato e stringere a mano la vite di tensione per bloccarlo. Proseguire a pagina 2.

AVVERTENZA: Quando si lavora con il gruppo bicchiere/bacinella e/o con i fluidi del contenitore di scarico/aspirazione, si consiglia di utilizzare dispositivi di protezione individuale "DPI" per evitare l'esposizione a possibili rifiuti pericolosi.

AVVERTENZA: Prima di cominciare, assicurarsi che il collettore dei residui solidi del contenitore, se presente, sia vuoto. In caso contrario, indossare i guanti per rimuovere il filtro monouso dal contenitore e gettarlo direttamente in un sacchetto a tenuta stagna per evitare la fuoriuscita di contenuto contaminato.

NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555.

FIG. 1:

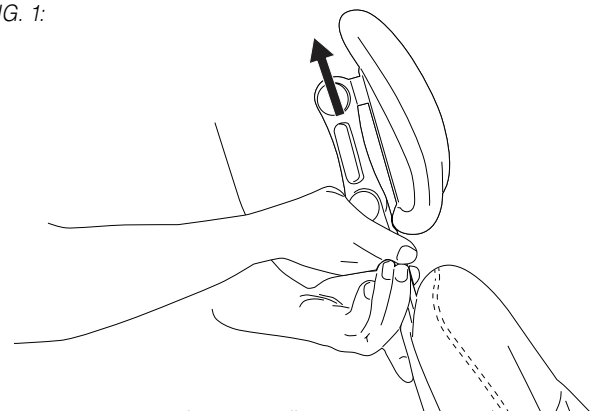

FIG. 2:

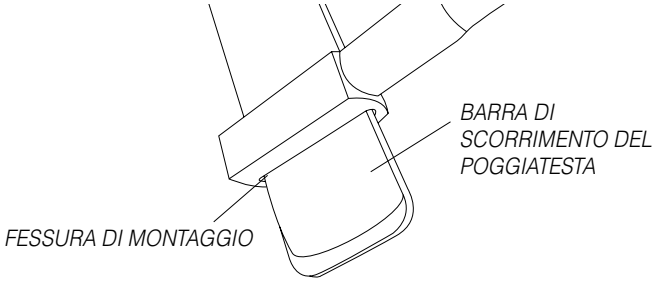

FIG. 3:

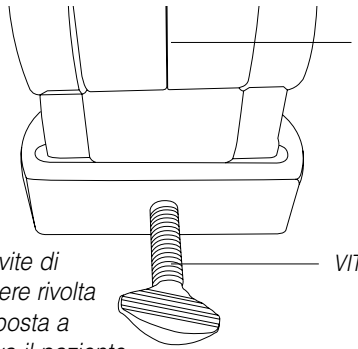

AVVERTENZA: La vite di tensione deve essere rivolta nella direzione opposta a quella in cui si trova il paziente.

PASSO 5: Innestare l'ugello dell'evacuatore HVE nell'alloggiamento; il braccio flessibile dell'assistente ricadrà dietro la poltrona (FIGG. 4-4.1).

NOTA: Nel caso in cui il modello dell'evacuatore HVE non sia compatibile con l'alloggiamento, sostituire il gruppo del cordone HVE con quello fornito in dotazione.

PASSO 6: Collegare il cordone dell'evacuatore HVE alla porta dell'evacuatore HVE (FIG. 5).

NOTA: L'illustrazione del contenitore di aspirazione potrebbe non corrispondere al modello in dotazione al cliente. Consultare il Manuale d'uso per comprendere il corretto posizionamento e collegamento dei cordoni. Per installare i cordoni dell'evacuatore HVE può essere necessario rimuovere un tappo dall'evacuatore HVE o dai cordoni degli evacuatori HVE esistenti.

FIG. 4:

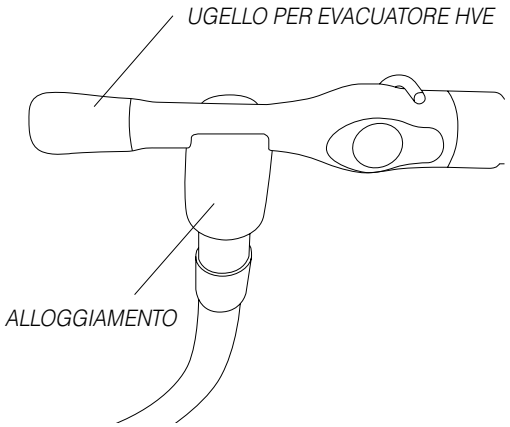

FIG. 4.1:

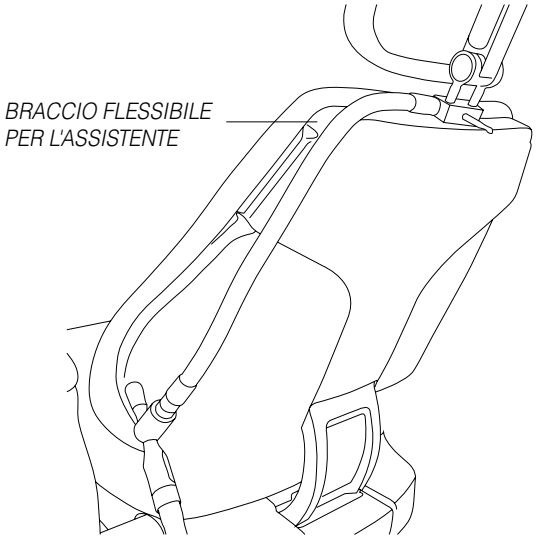

FIG. 5:

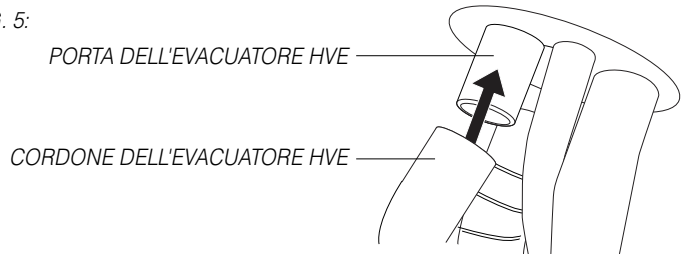

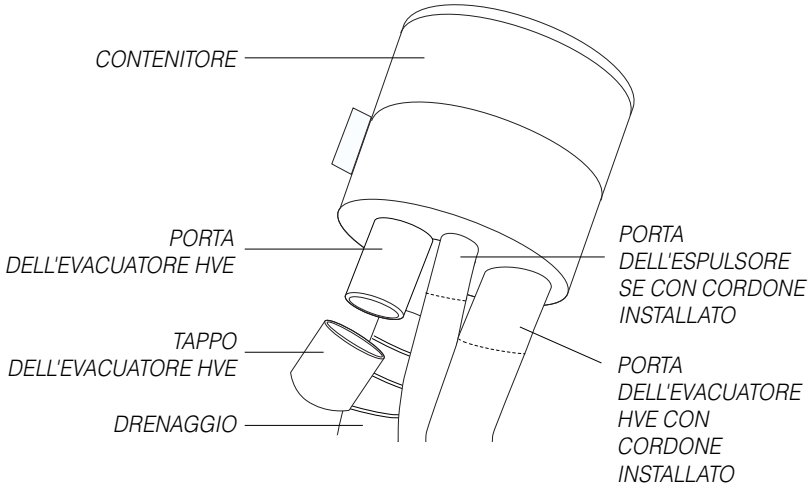

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459