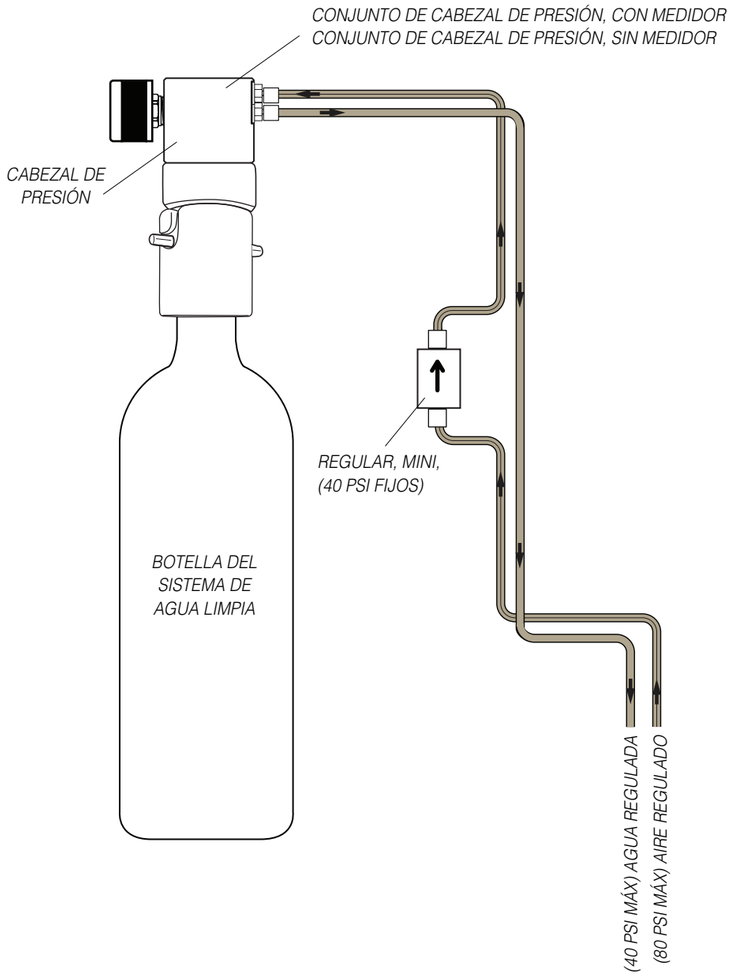


DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459



SISTEMA DE AGUA LIMPIA

# Forest
DENTALEZ



## REFERENCIA DE SÍMBOLOS DE ALERTA

Se debe prestar especial atención a las notificaciones de seguridad asociadas con lo siguiente cuando aparezcan en procedimientos de mantenimiento, operación y emergencia en la guía.

⚠ *ADVERTENCIA indica que podría ponerse en peligro la seguridad personal del paciente, usuario final o técnico si se ignora la ADVERTENCIA. No seguir las instrucciones podría causar una lesión.*

⚠ *PRECAUCIÓN indica que se debe seguir un procedimiento o tomar una precaución en particular para evitar irregularidades en el sistema o posibles daños al producto.*

ℹ *NOTA indica información especial para mejorar la facilidad de mantenimiento del producto, o para aclarar información importante.*

⚠ *PRECAUCIÓN: Las modificaciones de campo que alteren la seguridad eléctrica o mecánica de productos Forest™ están en conflicto con los requisitos del archivo de construcción de la agencia, y no están autorizadas por Forest.*

ℹ *NOTA: Verificación de instalación: Consulte la Guía del Usuario y realice todas las operaciones. Si las operaciones dan los resultados esperados, la instalación está completa. Si las operaciones no dan los resultados esperados, repase los pasos en INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN para confirmar la instalación correcta o llame a Soporte Técnico al 800-423-3555.*

## SOPORTE DE SILLÓN FIJO SIN CAJA LATERAL - CABLE UMBILICAL INTERNO

Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/64" (1.98 mm) y de 3/16" (4.76 mm)

⚠ *PRECAUCIÓN: Conexiones de agua y aire: Las líneas de agua de la unidad dental están diseñadas para conectarse a sistemas de agua entrante con un dispositivo antirretorno, un filtro de partículas con una malla de no más de 90 um, y líneas de aire entrante con un filtro de partículas con una malla de no más de 25um.*

*PASO 1:* Usar la medida indicada para montar el sistema de agua limpia (FIG. 1).

*PASO 2:* Conectar el sistema de agua limpia al poste y pasar el tubo por el agujero al interior del poste (FIG. 2).

*PASO 3:* Buscar la parte del cable umbilical de la unidad que coincida con el tubo y conectarlo (FIG. 3).

*PASO 4:* Instalar la botella (FIG. 4).

*FIG.1:*




*FIG. 2:*

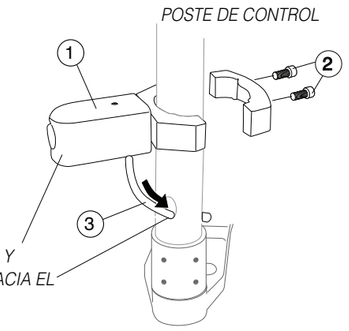


*FIG. 3:*

*FIG. 4:*

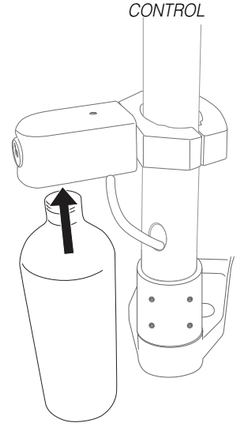

## *POSTE DE CONTROL DE PIVOTE – CABLE UMBILICAL INTERNO*

Herramientas requeridas: Llave Allen de 5/32" (3.96 mm)

⚠ *PRECAUCIÓN: Conexiones de agua y aire: Las líneas de agua de la unidad dental están diseñadas para conectarse a sistemas de agua entrante con un dispositivo antirretorno, un filtro de partículas con una malla de no más de 90 um, y líneas de aire entrante con un filtro de partículas con una malla de no más de 25um.*

*PASO 1:* Instalar el colector en el poste usando los tornillos (2) incluidos y pasar el tubo por el poste (FIG. 1).

*PASO 2:* Buscar la parte del cable umbilical de la unidad que coincida con el tubo y conectarlo (FIG. 2).

*PASO 3:* Instalar la botella (FIG. 3).

*FIG.1:*

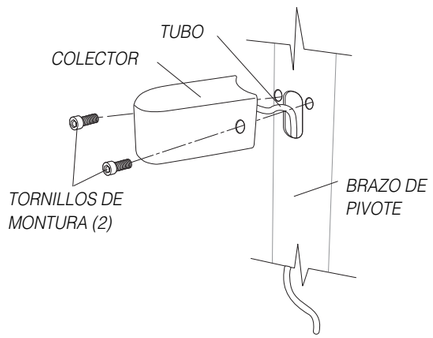


*FIG. 2:*

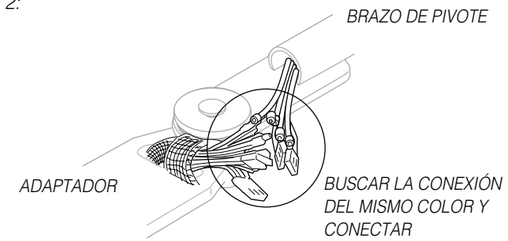


*FIG. 3:*

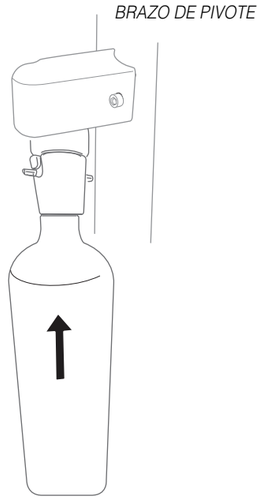




## *KITS DE ENSAMBLAJE DE DESCONEXIÓN RÁPIDA*

ℹ *NOTA: El material de la traba a rosca está diseñado para permitir retirar la botella del adaptador. Está diseñado para no ser permanente. Retire el exceso de traba a rosca del adaptador al volver a instalarlo.*

### *REEMPLACE/AGREGUE UN CONVERTIDOR DE BOTELLA AL CABEZAL DE PRESIÓN:*

*PASO 1:* Retirar la botella de agua del cabezal de presión (FIG. 1).

*PASO 2:* Aplicar una pequeña gota del material de traba a rosca en 2 vueltas enteras del convertidor y enroscar en el cabezal de presión (FIG. 2).

*PASO 3:* Dejar curar durante 30 minutos.

*PASO 4:* Instalar la botella con el adaptador de desconexión rápida en el convertidor y girarla para fijarla (FIG. 3).

### *AGREGAR EL ADAPTADOR DE DESCONEXIÓN RÁPIDA A LA BOTELLA:*

*PASO 1:* Aplicar una pequeña gota del material de traba a rosca en 2 vueltas enteras del adaptador de desconexión rápida y enroscar en la rosca de la botella (FIG. 2).

*PASO 2:* Dejar curar durante 30 minutos.

*PASO 3:* Instalar la botella con el adaptador de desconexión rápida en el convertidor y girarla para fijarla (FIG. 3).

*FIG. 1:*

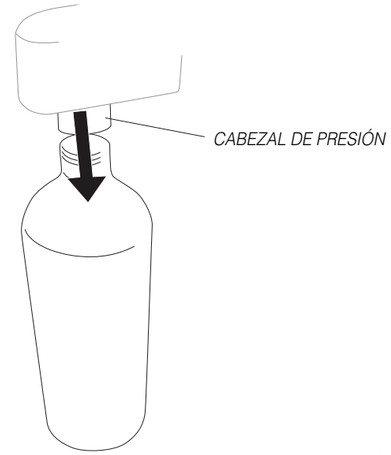


*FIG. 2:*

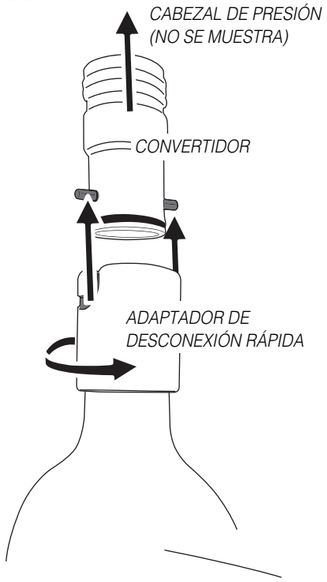

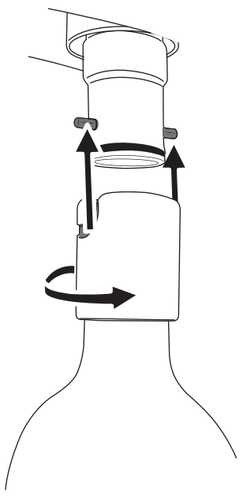
*FIG. 3:*