Forest

DENTALEZ

ADVARSELSSYMBOL-TAST

Sikkerhedsbemærkningerne i forbindelse med det følgende bør gives særlig opmærksomhed, når de optræder i vedligeholdelses-, betjenings- og nødprocedurer i vejledningen.

⚠ *ADVARSEL angiver, at patientens, slutbrugerens eller teknikerens personlige sikkerhed kan blive kompromitteret ved at se bort fra ADVARSLEN. Hvis instruktionerne ikke følges, kan det medføre personskade.*

⚠ *FORSIGTIG angiver, at en bestemt procedure eller forholdsregler skal følges for at undgå systemuregelmæssigheder eller mulig beskadigelse af produktet.*

❗ *BEMÆRK angiver særlig information for at gøre det nemmere at vedligeholde produktet eller for at tydeliggøre vigtige oplysninger.*

⚠ *ADVARSEL: Sæt kun stemplet i indgreb i højdejusteringscylinderen, efter at skamlen er samlet. Aktivering af stemplet før installation kan forårsage personskade.*

❗ *BEMÆRK: Installationsbekræftelse: Se betjeningsvejledningen og udfør alle handlinger. Hvis handlingerne udføres efter hensigten, er installationen fuldført. Hvis handlingerne ikke fungerer efter hensigten, skal du gennemgå trinene i installationsvejledningen for at bekræfte korrekt installation eller ringe til teknisk support på 800-423-3555.*

6176 DOCTOR'S COMFORT SKAMMEL

TRIN 1: Indsæt hjul i basen. Påfør et betydeligt tryk for at sikre, at hjulene sidder fast (FIG. 1-2).



FIG. 5: MONTERING AF RYGLÆM



FIG. 2: ALUMINIUMSBASE



FIG. 4: SÆDEMONTERING

FIG. 3: HØJDEJ-USTERINGS-CYLINDER



FIG. 1: HJUL

TRIN 2: Indsæt højdejusteringscylinderen i aluminiumsbunden (FIG. 3).

TRIN 3: Placer sædesamlingen oven på højdejusteringscylinderen (FIG. 4).

TRIN 4: Indsæt rygsamlingen i mekanismen under sædet, og stram knappen sikkert ved at dreje med uret (FIG. 5).

TRIN 5: Sid på skamlen for permanent at låse cylinderen i baen og sædet. Nu kan stemplet i højdejusteringscylinderen aktiveres ved at aktivere sædehøjdehåndtaget for at justere sædeplaceringen.

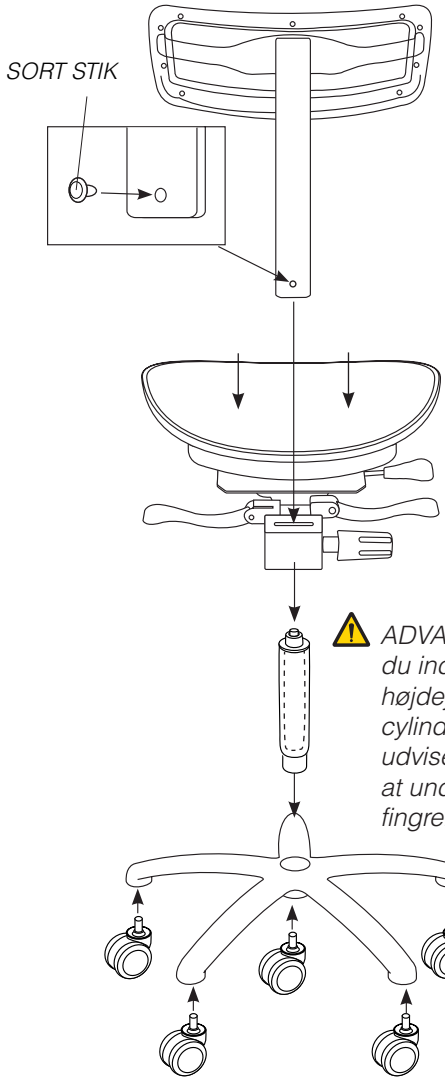

⚠ *ADVARSEL: Når du indsætter højdejusteringscylinderen, skal du udvise forsigtighed for at undgå at klemme fingrene.*

⚠ *ADVARSEL: Sørg for, at hjulene sidder godt fast, før du bruger skamlen.*

6187 ASSISTANT'S COMFORT SKAMMEL

TRIN 1: Indsæt hjul i basen. Påfør et betydeligt tryk for at sikre, at hjulene sidder korrekt (FIG. 1-2)

TRIN 2: Indsæt højdejusteringscylinderen i basen (FIG. 3).

TRIN 3: Skub den justerbare fodringover højdejusteringscylinderen og spænd fodringsknappen fast (FIG. 4).

TRIN 4: Sæt stopkraven oven på højdejusteringscylinderen og spænd sætskruerne godt fast (FIG. 5).

TRIN 5: Skub kromarmrøret oven på højdejusteringscylinderen, indtil det sidder godt fast (FIG. 6).

TRIN 6: Placer sædesamlingen oven på højdejusterings-cylinderen (FIG. 7).

TRIN 7: Skub den faste arm ind i armrøret. Spænd armrørsknoppen med uret for at fastgøre armen (FIG. 8).

TRIN 8: Sid på skamlen for permanent at låse cylinderen i bunden og sædet. Nu kan stemplet i højdejusteringscylinderen aktiveres ved at aktivere sædehøjdehåndtaget for at justere sædeplaceringen.



FIG. 8: SKRALDEARM



FIG. 7: MONTERING AF RYGLÆN



FIG. 6: SÆDEMONTERING



FIG. 5: ARMRØR I KROM



FIG. 4: JUSTERBAR FODRING

FIG. 3: HØJDEJUSTERINGSCYLINDER



FIG. 2: ALUMINIUMSBASE



FIG. 1: HJUL

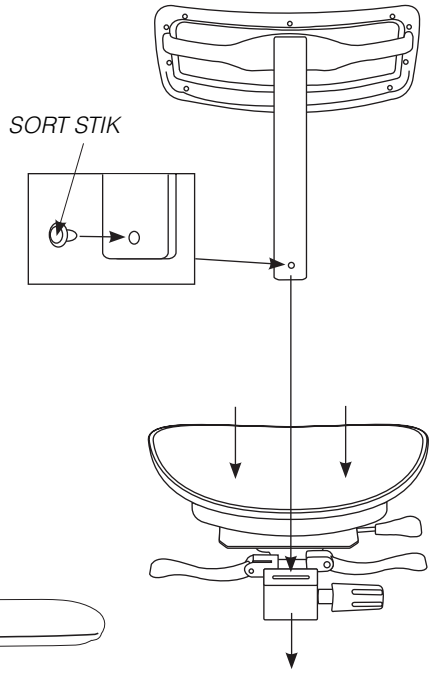

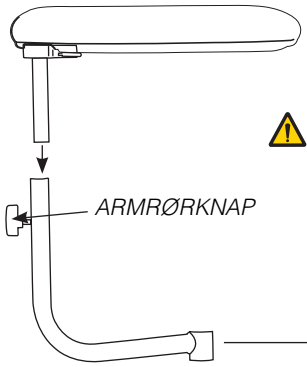

⚠ *ADVARSEL: Sørg for, at justeringsknapperne til armrør og fodring er strammet godt fast (ved at dreje med uret) for at forhindre eventuel glidning, der kan resultere i personskade.*

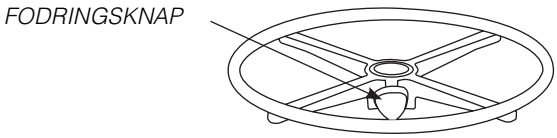

⚠ *ADVARSEL: Når du indsætter højdejusteringscylinderen, skal du udvise forsigtighed for at undgå at klemme fingrene.*

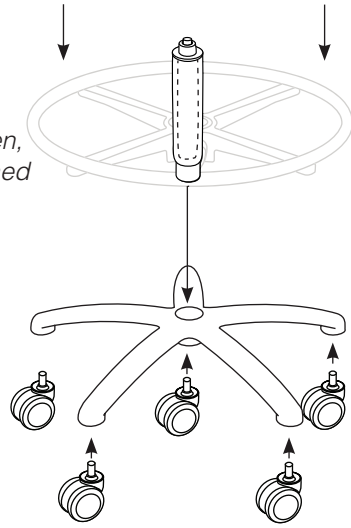

⚠ *ADVARSEL: Sørg for, at hjulene sidder godt fast, før du bruger skamlen.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE