Forest
DENTALEZ

ARMLÆN

⚠ *FORSIGTIG: For at minimere mulig skade på patienten er stolen udstyret med bevægelige armlæn, der gør det lettere at komme ind og ud. Husk at sænke armlænet ned for patienten (for lettere ind-/udstigning) ved start og afslutning af drift. Armlæn er ikke beregnet til at understøtte patientens vægt, når man går ind eller ud af stolen.*

TRIN 1: For at sænke armlænet skal du trække op i vippearmen, der er placeret på bagsiden af armsamlingen (FIG. 8).

TRIN 2: For at hæve armlænet løftes den sænkede ende af armlænet op, indtil armlænet stopper og klikker ind i den låste armlænsstilling.

FIG. 8: ARMHÅNDTAG

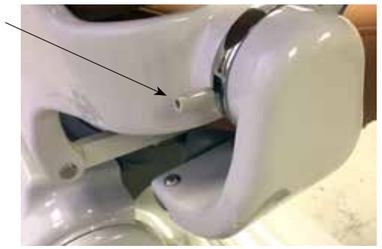

JUSTERING AF HOVEDSTØJENS SPÆNDING

TRIN 1: Fjern ryglænspuden (FIG. 9).

TRIN 2: Juster skruerne (FIG. 10).

TRIN 3: Genanbring ryglænspuden (FIG.11).

NØDVENDIGT VÆRKTØJ: Stjerneskruetrækker

FIG. 9: RYGLÆN



FIG. 10: SKRUER



FIG. 11: PUDE



PLEJE AF STOLEBETRÆK

⚠ *ADVARSEL: Se altid instruktionerne fra desinfektionsmiddelproducenten for at være sikker på, at opløsningen ikke er skadelig for mennesker eller de materialer, den kommer i kontakt med. For yderligere vejledning til rengøring og desinfektion af miljømæssige overflader henvises der til Forest™ Operatory Equipment Asepsis Operator's Guide samt anden infektionskontrolinformation kan findes i:*

Guidelines for Infection Control in Dental Health Care Settings på: www.cdc.gov

American Dental Association's anbefalinger kan findes på: www.ada.org

Organization for Safety and Asepsis Procedures' anbefalinger kan findes på: www.osap.org

⚠ *ADVARSEL: Følg alle producentens advarsler. Forest- eller polstringsproducenten kan ikke holdes ansvarlig for skader eller kvæstelser som følge af brug eller misbrug af rengøringsmidler. Rengøringsmidler kan indeholde skrappe eller ukendte opløsningsmidler; de er også underlagt formelændringer foretaget af producenten uden varsel. Hvis du bruger andre rengøringsmidler end de beskrevne, anbefales det på det kraftigste, at du først tester dem på et ikke iøjnefaldende område for at være sikker på, at de ikke beskadiger polstring, plastik eller metaloverflader.*

Korrekt vedligeholdelse og regelmæssig rengøring vil forhindre overdreven snavs i at samle sig. For at sikre, at kvalitetsstoffer holdes pæne i så lang tid som muligt, skal du følge disse retningslinjer for at forlænge Naugahyde® - stoffets levetid.

TIL LET TILSNITTELSE

TRIN 1: En opløsning af 10 % mild sæbe og varmt vand påført med en blød fugtig klud fjerner det meste snavs.

TRIN 2: Hvis det er nødvendigt, kan en opløsning af flydende rensemiddel og vand påføres med en blød børste. Tør rester af med en vandfugtet klud.

TIL MERE GENSTRIDIGE PLETTER

TRIN 1: Fugt en blød hvid klud med en opløsning af husholdningsblegemiddel (natriumhypoklorit); 10 % blegemiddel, 90 % vand.

TRIN 2: Gnid forsigtigt.

TRIN 3: Skyl med en vandfugtet klud for at fjerne blegemiddelkoncentration.

TRIN 4: Lad om nødvendigt en 1:10 fortyndet blegemiddelopløsning samles på det berørte område eller påfør den med en ren, gennemblødt klud i cirka 30 minutter. Skyl med en vandfugtet klud for at fjerne evt. rester.

GENDAN GLANS

For at gendanne glansen kan der bruges et tyndt lag møbelvokspray. Påfør i 30 sekunder og følg efter med en let polering med en ren hvid klud.

⚠ *FORSIGTIG: Disse oplysninger er ikke en garanti. Brug venligst alle rengørings- og desinfektionsmidler sikkert og som anvist i producentens retningslinjer. Brug af andre rengøringsmidler, desinfektionsmidler, balsam eller beskyttelsesmidler anbefales ikke og kan forringe stoffets ydeevne og kan ugyldiggøre polstringsgarantien.*

⚠ *FORSIGTIG: En række forskellige slags tøj og tilbehør kan indeholde farvestoffer, der kan smitte af på lysere farver, afhængigt af variationer i temperatur og luftfugtighed. Farveafsmitning er svær at kontrollere, ikke altid helt forebyggelig og kan være irreversibel. Stoffet beskytter muligvis ikke mod utilsigtede pletter eller permanent blæk.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

Se Forest™ General Information Operator's Guide for en ordliste over symboler, termer, EMC/elektrisk sikkerhedserklæring og brugervejledning.

INDIKATIONER FOR BRUG/TILSIGTET ANVENDELSE Tandlægestolen er et mekanisk sæde beregnet til at placere tandpatienter for bedre adgang og synlighed til mundhulen af en tandlæge under diagnostisk og terapeutisk behandling i et klinisk miljø. Der er ingen kontraindikationer for dette produkt.

TILTÆNKT PATIENTGRUPPE Der er ingen begrænsninger for patientpopulationen, der kan behandles med Forest-udstyr.

FORVENTET LEVETID Med korrekt vedligeholdelse og service er Forest produkter designet til at holde en defineret "levetid" under normal brug (baseret på ca. 50 patienter om ugen) på 5 år fra fremstillingsdatoen, med undtagelse af servicebare komponenter. Nogle komponenter kan blive forældede på grund af teknologiske ændringer eller på grund af produktforbedringer, og kan derfor nødvendiggøre produktopdateringer eller -opgraderinger. Ved afslutningen af den definerede levetid kræver alle produkter kontrol og eftersyn af en uddannet servicetekniker før fortsat brug. Herefter kræves yderligere kontrol og eftersyn hvert 5. år.

ADVARSEL: For at forhindre mulig skade på grund af utilsigtet betjening, efterlad ikke små børn uden opsyn.

ADVARSEL: Ingen dele, der kan repareres af brugeren, er placeret i gulvboksen. Kun autoriserede og uddannede fagfolk bør få adgang til netspændingskomponenter i stolebasen.

ADVARSEL: Sluk for stolen og tag netledningen ud, før du udskifter sprungne sikring(er). For nemheds skyld er der ekstra sikringer i pumpedækslet.

FORSIGTIG: Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller efter ordre fra en tandlæge, der er licenseret af loven i den stat, hvor han/hun er bemyndiget til at bruge eller ordinere brug af enheden.

FORSIGTIG: Før du forsøger at flytte stolen, skal den sænkes til dens laveste stilling og låses på plads ved nul graders rotation. Det anbefales på det kraftigste, at tilbehør, såsom lys og enheder, fjernes før flytning.

BEMÆRK: Se servicehåndbogen og installationsvejledningen for fuldstændige tekniske beskrivelser.

TEKNISK BESKRIVELSE/SPECIFIKATIONER

Indgangsspænding	115 VAC/230 VAC 50/60Hz
Styrespænding	5 VDC
Sikringer	115VAC F1/F2 -10A, F3-125mA 230VAC F1/F2 - 6.3A, F3-63mA
Arbejdscyklus	5% (intermitterende 25s ON, 300s OFF)
Beskyttelse mod elektriske farer	Klasse I enhed, Type B
Maksimal patientvægt	300 lbs (136 kg)
Leveringssystemkapacitet	125 lbs (57 kg)
Samlet løftekapacitet	450 lbs (225 kg)
Støjniveau	<40 dB

PLACERING AF FORBINDENDE HOVEDSTØTTE

Korrekt placering af den forbindende hovedstøtte, der støtter hovedet i dets naturlige forhold til rygsøjlen, reducerer spændinger i nakke- og kæbemusklerne, hvilket mindsker den typiske anmodning om at "åbne munden mere op".

TRIN 1: Mens du er i oprejst position, skal du trykke udløsermekanismen til højre helt ned og justere hovedstøtten, så den passer til patientens højde (FIG. 1).

TRIN 2: Led hovedstøttepuden, så den kommer i kontakt med bagsiden af patientens hoved.

TRIN 3: Læn patienten tilbage. Finjuster om nødvendigt hovedstøttens position ved hjælp af udløsermekanismen (FIG. 2).

BEMÆRK: Det anbefales at bruge engangs-hoved-støttebetræk for at forhindre tilsmudsning af hovedstøtten.

FIG. 1: OPRETSTÅENDE

FIG. 2: LÆN TILBAGE

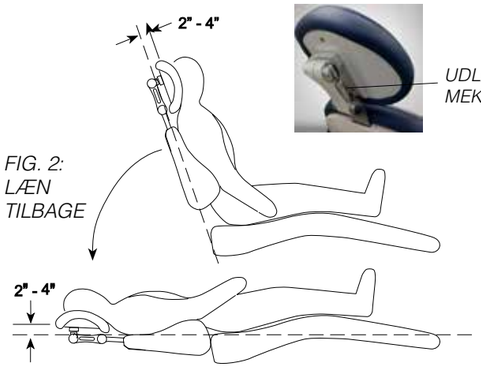

HOVEDSTØTTEINDSTILLING TIL KØRESTOL

ADVARSEL: Sørg for, at kørestolens hjullåse er aktiveret, før patientens hovedet placeres på hovedstøtten.

Hovedstøtten kan bruges til kørestolspatienter.

TRIN 1: Skub hovedstøtten op, indtil den er fri fra stolen. Drej hovedstøtten 180°.

TRIN 2: Skub den omvendte hovedstøtte tilbage i ryglænet og skub den helt ned.

TRIN 3: Kør stolen til den når sine fulde rygstilling. Juster hovedstøttens højde ved at flytte stolen op eller ned (ved hjælp af base up-funktionen på fodkontakten eller touchpaden).

TRIN 4: Placer patienten. Finjuster om nødvendigt hovedstøttens stilling (FIG. 3).

STOLEROTATION

TRIN 1: For at dreje stolen låses stolens bremse op ved at flytte bremsehåndtaget på stoleryggen til højre (FIG. 4).

TRIN 2: Drej stolen til den ønskede stilling.

TRIN 3: Lås stolebremsen ved at flytte bremsehåndtaget på stoleryggen til venstre.

FODKONTAKT OG TOUCHPAD-BETJENING (FIG. 5 OG 6)

FORSIGTIG: Brug barrierebeskytter for at forhindre oversprøjtning af forurenende stoffer fra for tidlig ældning af elektroniske komponenter.

BEMÆRK: Almindelige forudindstillinger: 1, 2 og 3 for funktionsstillinger og 4 for patientudgang.

MANUEL PLACERING

TRIN 1: Vælg kørselsretningen (Base op; Base ned; Tilbage op; Tilbage ned.

TRIN 2: Tryk og slip den tilsvarende knap for at flytte stolen til den fabriksindstillede rejsegrænse.

BEMÆRK: Hvis du holder retningsknappen nede, kører stolen, indtil knappen slippes.

PROGRAMMERING OG OMPROGAMERING AF AUTOSTILLINGER

TRIN 1: Brug de manuelle touchpad-kontroller til at manøvrere stolen til den ønskede stilling.

TRIN 2: Tryk kortvarigt på programknappen (FIG. 7), stolen bipper to gange, hvilket indikerer, at den er klar til at tildele denne stilling til en auto-knap.

TRIN 3: Tryk på en auto-knap for at tildele den til denne stilling. Stolen bipper 3 gange for at indikere, at programmet er afsluttet.

TRIN 4: Programfejl indikeres med mere end 3 bip.

TRIN 5: Gentag trin 1-3 for at programmere de resterende auto-knapper.

BEMÆRK: Omprogrammering af en ny autostilling sletter den gamle stilling.

AKTIVERING AF AUTOSTILLINGER

TRIN 1: Tryk én gang på autoknappen #1, 2, 3 eller 4 på fodkontakten eller touchpad-kontrollen.

TRIN 2: Der lyder et bip.

TRIN 3: Stolen stopper automatisk i den valgte, programmerede stilling.

BEMÆRK: Hvis du trykker på en hvilken som helst knap på en stolebetjening, mens stolen bevæger sig til en programmeret stilling, stopper stolen med at at bevæge sig øjeblikkeligt, og der lyder tre korte bip. For at fortsætte og fuldføre den automatiske indstilling af stolen skal du blot trykke på den ønskede stillingknap en gang til.

FIG. 3: HOVEDSTØTTEINDSTILLING TIL KØRESTOL

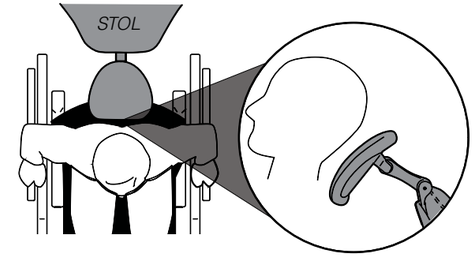

FIG. 4: STOLEROTATION

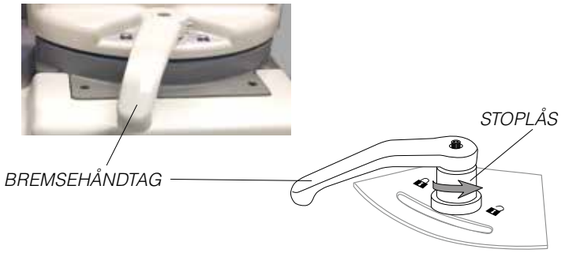

FIG. 5: FODKONTAKT

FIG. 6: TOUCHPAD-KONTROL

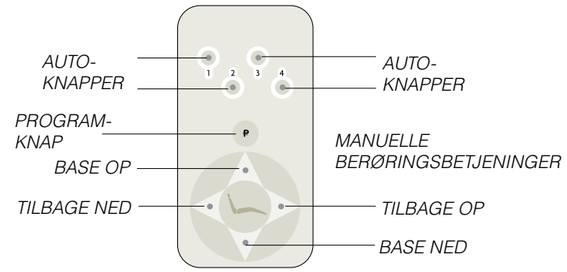

FIG. 7: PROGRAMKNAP