Forest
DENTALEZ

HÅNDFRI HVE

TRIN 1: Sæt HVE-dysen ind i holderen (FIG. 1).

TRIN 2: Flexible assistant's arm falder bag stolen (FIG. 2).

TRIN 3: Drej spændeskruen til højre for at stramme og til venstre for at løsne (fig. 3).

⚠ *ADVARSEL: Spændeskruen skal vende væk fra patienten.*

⚠ *ADVARSEL: Se Forest™ Operatory Equipment Asepsis and HVE/SE Reprocessing and Maintenance Operator's Guide for infection control procedures.*

⚠ *FORSIGTIG: HVE bør ikke sidde i holderen, mens patienten sætter sig i stolen forud for behandling eller forlader stolen.*

FIG. 1:

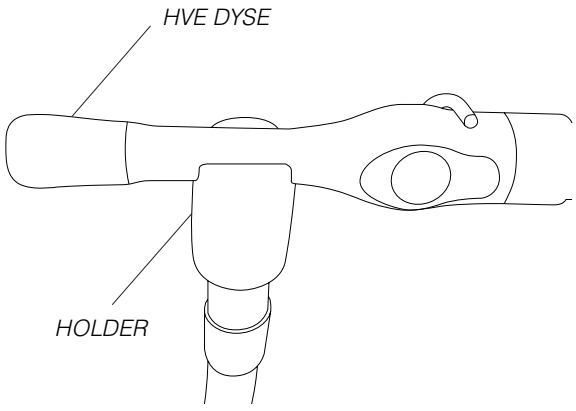

FIG. 2:

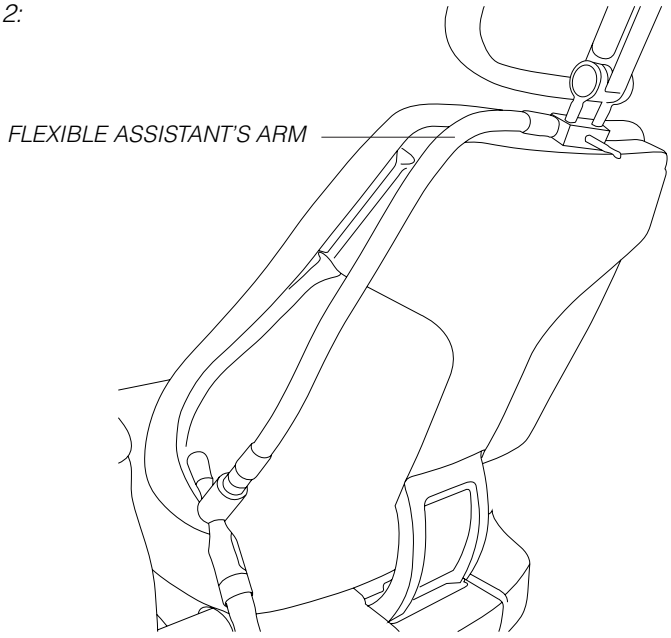

FIG. 3:

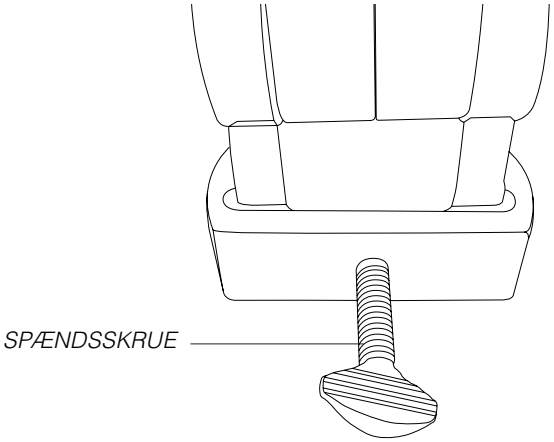

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459