ARMLÆN

⚠ *FORSIGTIG: For at minimere mulig skade på patienten er stolen udstyret med bevægelige armlæn, der gør det lettere at komme ind og ud. Husk at sænke armlænet ned for patienten (for lettere ind-/udstigning) ved behandlingens start og afslutning. Armlænene er ikke beregnet til at understøtte patientens vægt, når man går ind eller ud af stolen.*

TRIN 1: For at sænke armlænet skal du trykke på knappen på armsamlingen (FIG. 10).

TRIN 2: For at hæve armlænet løftes den sænkede ende af armlænet op, indtil armlænet stopper og klikker ind i den låsende armlænsposition.

FIG. 10: ARMKNAP

STOLEROTATION

TRIN 1: For at dreje stolen låses stolens bremse op ved at flytte bremsehåndtaget bag på stolen til højre (FIG. 11).

TRIN 2: Drej stolen til den ønskede stilling.

TRIN 3: Lås stolebremsen ved at flytte bremsehåndtaget bag på stolen til venstre.

FIG. 11: DREJLIGT BREMSEHÅNDTAG

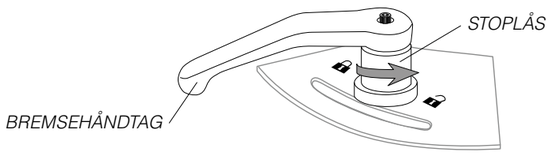

PLEJE AF STOLEBETRÆK

⚠ *ADVARSEL: Se altid instruktionerne fra desinfektionsmiddel-producenten for at være sikker på, at løsningen ikke er skadelig for mennesker eller de materialer, den kommer i kontakt med. For yderligere vejledning i rengøring og desinfektion af miljøoverflader, henvises der til operatørvejledningen Forest™ Operatory Equipment Asepsis samt anden smitte-bekæmpelsesinformation, der kan findes i:*

Guidelines for Infection Control in Dental Health Care Settings på: www.cdc.gov

American Dental Association's anbefalinger på: www.ada.org

Organization for Safety and Asepsis Procedures' anbefalinger på: www.osap.org

⚠ *ADVARSEL: Følg alle fabrikantens advarsler. Forest eller Ultraleather® kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af brug eller misbrug af noget rengøringsmiddel. Rengøringsmidler kan indeholde hårde eller ukendte opløsningsmidler; de kan også være genstand for formelændringer foretaget af producenten uden varsel. Hvis du bruger andre rengøringsmidler end dem, der er beskrevne, anbefales det på det kraftigste, at du tester dem først i på et diskret område for at være sikker på, at de ikke beskadiger polstring, plastik eller metaloverflader.*

Korrekt vedligeholdelse og regelmæssig rengøring forhindrer betydelige mængder snavs i at ophobe sig. For at hjælpe med at holde kvalitetsstoffer pæne og rene, følg disse retningslinjer for at forlænge Naugahyde®-stoffets levetid.

TRIN 1: Tør spild op, så snart det opstår, ved hjælp af sæbe og VAND eller alkoholbaserede rengøringsmidler.

TRIN 2: Desinficer med desinfektionsmidler såsom en opløsning bestående af (1:5) blegemiddel/VAND.

TRIN 3: Ved genstridige pletter tørres af med isopropylalkohol hurtigst muligt.

TRIN 4: Skyl alle opløsningsrester grundigt af med RENT VAND og LUFTTØR og LUFT tør.

⚠ *FORSIGTIG: Disse oplysninger udgør ikke en garanti. Brug venligst alle rengørings- og desinfektionsmidler på sikker vis og som anvist efter producentens retningslinjer. Brug af andre rengøringsmidler, desinfektionsmidler, skyllemidler eller beskyttelsesmidler anbefales ikke og kan forringe stoffets ydeevne og kan ugyldiggøre polstringsgarantien.*

⚠ *FORSIGTIG: Noget tøj og tilbehør kan indeholde farvestoffer, der kan smitte af på lysere farver, afhængigt af variationer i temperatur og luftfugtighed. Farveafsmitning er svær at kontrollere, kan ikke altid helt forebygges, og kan evt være irreversibel. Stoffet beskytter muligvis ikke mod utilsigtede pletter eller permanent blæk.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

3900/3901 STOL

Forest
DENTALEZ

OPERATØRVEJLEDNING

Se Forest™ Gene[ral] Information Operator's Guide for en ordliste over symboler, termer, EMC/elektrisk sikkerhedserklæring og brugervejledning.

INDIKATIONER FOR BRUG/TILSIGTET ANVENDELSE Tandlægestolen er et mekanisk sæde beregnet til at placere tandpatienter for bedre adgang og synlighed til mundhulen af en tandlæge under diagnostisk og terapeutisk behandling i et klinisk miljø. Der er ingen kontraindikationer for dette produkt.

TILTÆNKT PATIENTGRUPPE Der er ingen begrænsninger for patientpopulationen, der kan behandles med Forest-udstyr.

FORVENTET LEVETID Med korrekt vedligeholdelse og service er Forest produkter designet til at holde en defineret "levetid" under normal brug (baseret på ca. 50 patienter om ugen) på 5 år fra fremstillingsdatoen, med undtagelse af servicebare komponenter. Nogle komponenter kan blive forældede på grund af teknologiske ændringer eller på grund af produktforbedringer, og kan derfor nødvendiggøre produktopdateringer eller -opgraderinger. Ved afslutningen af den definerede levetid kræver alle produkter kontrol og eftersyn af en uddannet servicetekniker før fortsat brug. Herefter kræves yderligere kontrol og eftersyn hvert 5. år.

ADVARSEL: For at forhindre mulig skade på grund af utilsigtet betjening, efterlad ikke små børn uden opsyn.

ADVARSEL: Ingen dele, der kan repareres af brugeren, er placeret i gulvboksen. Kun autoriserede og uddannede fagfolk bør få adgang til netspændingskomponenter i stolebasen.

ADVARSEL: Sluk for stolen og tag netledningen ud, før du udskifter sprungne sikring(er). For nemheds skyld er der ekstra sikringer i pumpedækslet.

FORSIGTIG: Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller på ordre fra en tandlæge, der er licenseret af loven i den stat, hvor han/hun praktiserer og tilsigter at bruge eller ordinere brug af enheden.

FORSIGTIG: Før du forsøger at flytte stolen, skal den sænkes til dens laveste position og låses på plads ved nul graders rotation. Det anbefales på det strengeste, at tilbehør, såsom lys og enheder, fjernes før flytning.

BEMÆRK: Se servicehåndbogen og installationsvejledningen for fuldstændige tekniske beskrivelser.

TEKNISK BESKRIVELSE/SPECIFIKATIONER

Indgangsspænding	115 VAC/230 VAC 50/60Hz
Styrespænding	5 VDC
Sikringer	115VAC F1/F2 -10A, F3-125mA 230VAC F1/F2 - 6.3A, F3-63mA
Arbejdscyklus	5% (intermitterende 25s ON, 300s OFF)
Beskyttelse mod elektriske farer	Klasse I enhed, Type B
Maksimal patientvægt	300 lbs (136 kg)
Leveringssystemkapacitet	125 lbs (57 kg)
Samlet løftekapacitet	450 lbs (225 kg)
Støjniveau	<40 dB

PLACERING AF FORBINDENDE HOVEDSTØTTE

Korrekt placering af den forbindende hovedstøtte, der støtter hovedet i dets naturlige forhold til rygsøjlen, reducerer spændinger i nakke- og kæbemusklerne, hvilket mindsker den typiske anmodning om at "åbne munden mere op".

TRIN 1: Mens du er i oprejst position, skal du trykke udløsermekanismen til højre helt ned og justere hovedstøtten, så den passer til patientens højde (FIG. 1).

TRIN 2: Led hovedstøttepuden, så den kommer i kontakt med bagsiden af patientens hoved.

TRIN 3: Læn patienten tilbage. Finjuster om nødvendigt hovedstøttens position ved hjælp af udløsermekanismen (FIG. 2).

BEMÆRK: Det anbefales at bruge engangs-hovedstøttebetræk for at forhindre tilsmudsning af hovedstøtten.

FIG. 1: OPRETSTÅENDE

FIG. 2: LÆN TILBAGE

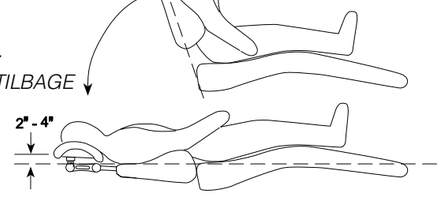

HOVEDSTØTTEINDSTILLING TIL KØRESTOL

ADVARSEL: Sørg for, at kørestolens hjullåse er aktiveret, før patientens hovedet placeres på hovedstøtten.

Hovedstøtten kan bruges til kørestolspatienter.

TRIN 1: Skub hovedstøtten op, indtil den er fri fra stolen. Drej hovedstøtten 180°.

TRIN 2: Skub den omvendte hovedstøtte tilbage i ryglænet og skub den helt ned.

TRIN 3: Kør stolen til den når sine fulde rygstilling. Juster hovedstøttens højde ved at flytte stolen op eller ned (ved hjælp af BASE OP-funktionen på fodkontakten eller touchpaden).

TRIN 4: Placer patienten. Finjuster om nødvendigt hovedstøttens stilling (FIG. 3).

FODKONTAKT OG TOUCHPAD-BETJENING (FIG. 5 OG 6)

*FORSIGTIG: Brug barrierebeskytter for at forhindre overspr*øjtning af forurenende stoffer fra for tidlig ældning af elektroniske komponenter.

BEMÆRK: Almindelige forudindstillinger: 1, 2 og 3 for funktionsstillinger og 4 for patientudgang.

MANUEL PLACERING

TRIN 1: Vælg kørselsretningen (Base op; Base ned; Tilbage op; Tilbage ned.

TRIN 2: Tryk og slip den tilsvarende knap for at flytte stolen til den fabriksindstillede rejsegrænse.

BEMÆRK: Hvis du holder retningsknappen nede, kører stolen, indtil knappen slippes.

PROGRAMMERING OG OMPROGAMERING AF AUTOSTILLINGER

TRIN 1: Brug de manuelle touchpad-kontroller til at manøvrere stolen til den ønskede stilling.

TRIN 2: Tryk kortvarigt på programknappen (FIG. 7), stolen bipper to gange, hvilket indikerer, at den er klar til at tildele denne stilling til en auto-knap.

TRIN 3: Tryk på en auto-knap for at tildele den til denne stilling. Stolen bipper 3 gange for at indikere, at programmet er afsluttet.

TRIN 4: Programfejl indikeres med mere end 3 bip.

TRIN 5: Gentag trin 1-3 for at programmere de resterende auto-knapper.

BEMÆRK: Omprogrammering af en ny autostilling sletter den gamle stilling.

AKTIVERING AF AUTOSTILLINGER

TRIN 1: Tryk én gang på autoknappen #1, 2, 3 eller 4 på fodkontakten eller touchpad-kontrollen.

TRIN 2: Der lyder et bip.

TRIN 3: Stolen stopper automatisk i den valgte, programmerede stilling.

BEMÆRK: Hvis du trykker på en hvilken som helst knap på en stolebetjening, mens stolen bevæger sig til en programmeret stilling, stopper stolen med at at bevæge sig øjeblikkeligt, og der lyder tre korte bip. For at fortsætte og fuldføre den automatiske indstilling af stolen skal du blot trykke på den ønskede stillingknap en gang til.

JUSTERING AF HOVEDSTØTTENS SPÆNDING

TRIN 1: Fjern ryglænspuden (FIG. 7).

TRIN 2: Juster skruerne (FIG. 8).

TRIN 3: Sæt ryglænspuden tilbage på plads (FIG. 9).

NØDVENDIG VÆRKTØJ: Phillips skruetrækker

FIG. 3: HOVEDSTØTTEINDSTILLING TIL KØRESTOL

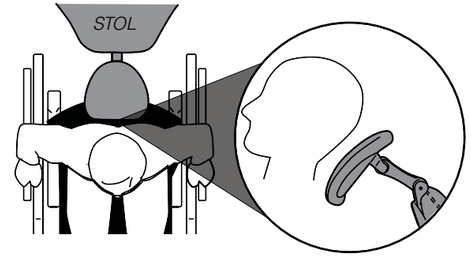

FIG. 4: PROGRAMKNAP

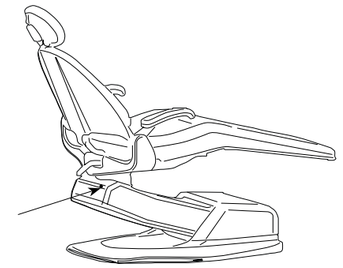

FIG. 5: FODKONTROL

FIG. 6: TOUCHPAD-BETJENING

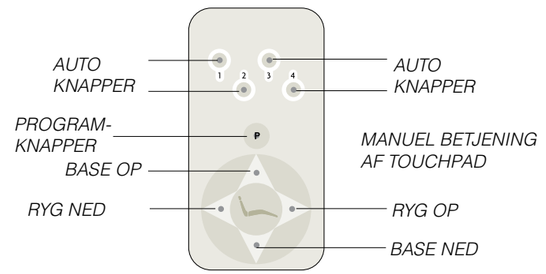

FIG. 7: RYGLÆN



FIG. 8: SKRUER



FIG. 9: PUDE