Forest

DENTALEZ

Alle kontrolfunktioner er placeret under sidepanelet.

AUTOMATISK HÅNDSTYKSSTYRING

MASTER TIL/FRA (FIG. 1)

Tænder for luft og vand for hele systemet. Denne omskiftningsfunktion skifter mellem luftaktiverede masterventiler i forsyningskassen. Skub kontakten mod On for at aktivere systemet. Sluk altid kontakten, når enheden ikke er i brug.

HÅNDSTYKTRYKMÅLER (FIG. 2)

Indikerer drivlufttryk til håndstykket.

JUSTERING AF DRIVLUFTTRYK (FIG. 3)

Gør det muligt at justere håndstykket til dets producents anbefalede driftstryk. Drej justeringsskruen mod uret for at øge trykket, med uret for at mindske trykket.

JUSTERING AF VANDKØLEVÆSKEFLOW (FIG. 4)

Tillader individuel justering af kølevæske til håndstykkerne. Drej knappen mod uret for at øge flowet, med uret for at mindske flowet.

SKYLNING AF HÅNDSTYKKE (FIG. 5)

Skyller vandledninger i håndstykkets ordontologiske enhed (DUWL).

⚠ *ADVARSEL: Se Forest™ Dental Unit Water Line Maintenance Operator's Guide for detaljerede procedurer for vedligeholdelse af DUWL.*

LUFTKØLEVÆSKEFLOWKONTROL (FIG. 6)

Tillader justering af håndstykkerne. Drej knappen mod uret for at øge flowet, med uret for at mindske flowet.

VANDKØLEVÆSKE TIL/FRA (PLACERET PÅ FODPEDALEN)

Aktiverer håndstykkets vandkølevæskesystem. Skub kontakten mod den røde prik for at aktivere vandkølevæsken.

PNEUMATISK BREMSE (FIG. 7)

Aktiverer den fleksible armbremse. Knappen er placeret på håndtaget på kontrolhovedet. Tryk på knappen for at udløse bremsen.

AUTOMATISK HÅNDSTYKKEHOLDER (FIG. 8)

Signalerer det automatiske kontrolsystem til at levere drivluft og luft/vandkølevæske til håndstykket, når det løftes ud af sin holder. Når håndstykket sættes tilbage i holderen, stopper et signal til det automatiske styresystem tilførsel af drivluft og luft/vandkølevæske.

DREJELIGE MONTAGEDELE (UNDER HYLDEN) (FIG. 9)

Løsn sætskruen for at justere drejespændingen. Når den er løs, drejes den store møtrik for at justere spændingen. Når den er indstillet korrekt, spændes sætskruen igen for at sikre den ønskede stilling.

ℹ *BEMÆRK:Værktøjssæt placeret inde i styrehovedet til eksterne justeringer.*

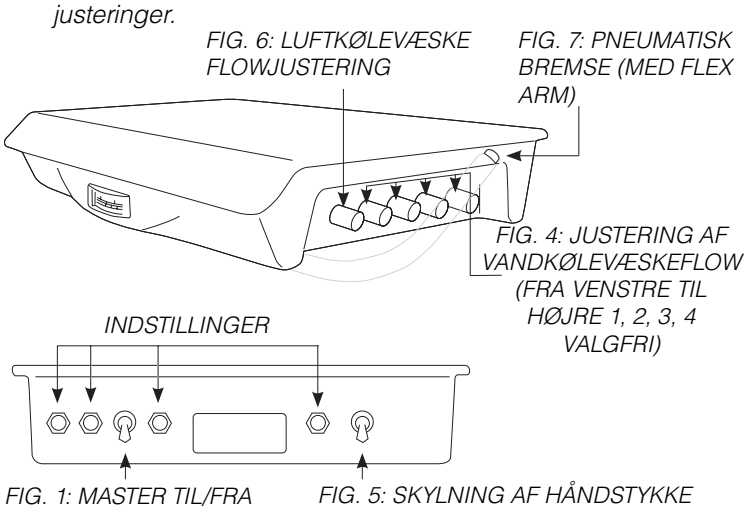

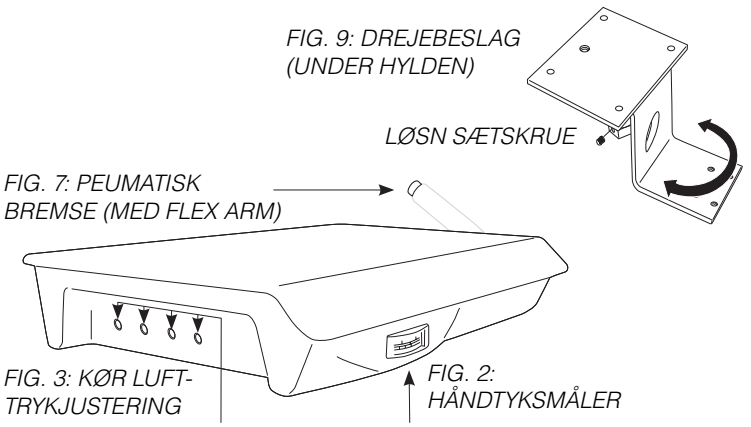

FIG 8: AUTOMATISK HÅNDSTYKKEHOLDER (FRA VENSTRE TIL HØJRE 1, 2, 3, 4 VALGFRI)

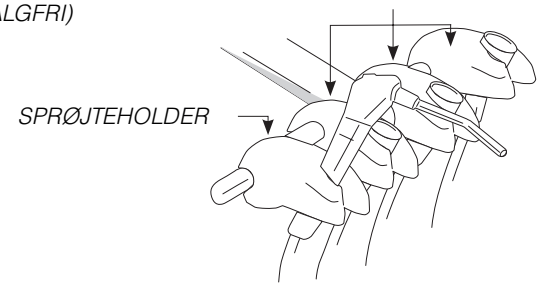

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

4.7.21 0097-331 Rev. J