Forest

DENTALEZ

Alle kontrolfunktioner er placeret under sidepanelet.

## AUTOMATISK HÅNDSTYKSSTYRING

### MASTER TIL/FRA (FIG. 1)

Tænder for luft og vand for hele systemet. Denne omskiftningsfunktion skifter mellem luftaktiverede masterventiler i forsyningskassen. Skub kontakten mod On for at aktivere systemet. Sluk altid kontakten, når enheden ikke er i brug.

### HÅNDSTYKTRYKMÅLER (PLACERET I STYREHOVEDET)

Indikerer drivlufttryk til håndstykket.

### JUSTERING AF DRIVLUFTTRYK (FIG. 2)

Gør det muligt at justere håndstykket til dets producents anbefalede driftstryk. Drej justeringsskruen mod uret for at øge trykket, med uret for at mindske trykket.

### JUSTERING AF VANDKØLEVÆSKEFLOW (FIG. 3)

Tillader individuel justering af kølevæske til håndstykkerne. Drej knappen mod uret for at øge flowet, med uret for at mindske flowet.

### SKYLNING AF HÅNDSTYKKE (FIG. 4)

Skyller vandledninger i håndstykkets ordontologiske enhed (DUWL).

⚠ *ADVARSEL: Se Forest™ Dental Unit Water Line Maintenance Operator's Guide for detaljerede procedurer for vedligeholdelse af DUWL.*

### LUFTKØLEVÆSKEFLOWKONTROL (FIG. 5)

Tillader justering af håndstykkerne. Drej knappen mod uret for at øge flowet, med uret for at mindske flowet.

### VANDKØLEVÆSKE TIL/FRA (PLICERET PÅ FODPEDALEN)

Aktiverer håndstykkets vandkølevæskesystem. Skub kontakten mod den røde prik for at aktivere vandkølingsvæsken.

### PNEUMATISK BREMSE (FIG. 6)

Aktiverer den fleksible armbremse. Knappen er placeret på håndtaget på styrehovedet. Tryk på knappen for at udløse bremsen.

### AFMONTERING AF LÅG (FIG. 7)

Med låget lige foran dig:

*TRIN 1:* Spred venstre og højre side af låget udad og opad.

*TRIN 2:* Flyt piskearmene fremad med venstre arm.

*TRIN 3:* Tag fat om bagsiden (midten) af låget og træk det op med højre hånd.

*BEMÆRK: Et værktøjssæt er placeret inde i styrehovedet til eksterne justeringer.*

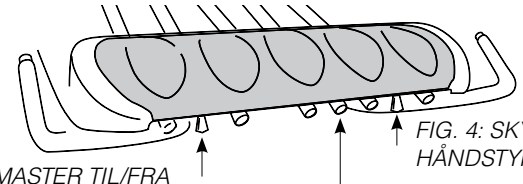

*FIG. 1: MASTER TIL/FRA*

*FIG. 4: SKYLNING AF HÅNDSTYKKE*

*FIG. 5: JUSTERING AF LUFTKØLEVÆSKEFLOW*

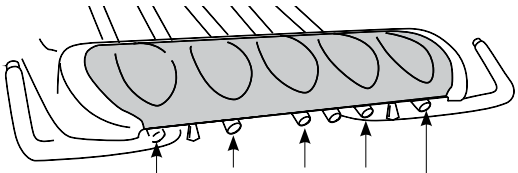

*FIG. 3: FLOWJUSTERING AF VANDKØLEVÆSKE*

*(FLUGT MED PISKE FRA VENSTRE TIL HØJRE 1, 2, 3, 4, 5)*

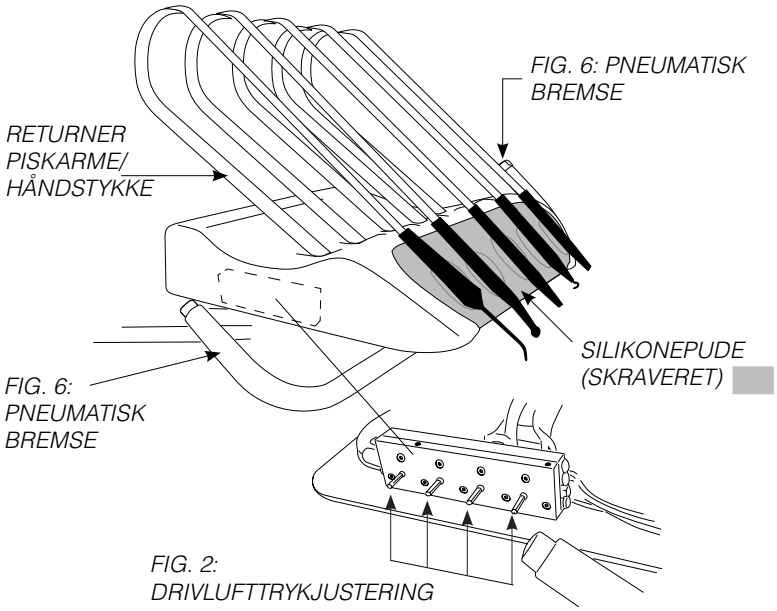


*FIG. 2: DRIVLUFTTRYKJUSTERING*

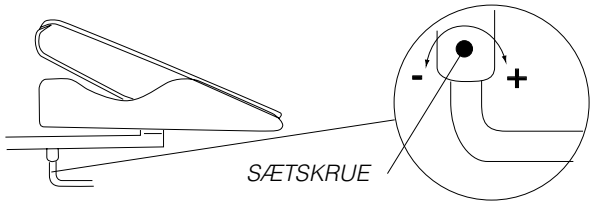


*FIG. 7:*

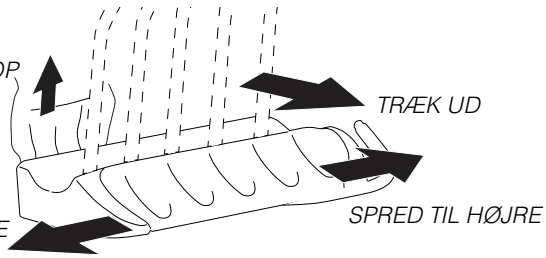


*DTE OREGON, INC.* *DENTALEZ.COM*

*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715*

CE 0459

4.7.21 0097-334 Rev. L 1 van 1