Forest
DENTALEZ

Alle kontroller er placeret på sidepanelerne.

AUTOMATISK BETJENING AD HÅNDSTYKKE

MASTER TIL/FRA (FIG. 1)
Tænder for luft og vand for hele systemet. Denne omskifter styrer de luftaktiverede masterventiler i forsyningskassen. Skub kontakten mod On for at aktivere systemet. Sluk altid kontakten, når enheden ikke er i brug.

HÅNDSTYKKETRYKMÅLER (FIG. 2)
Indikerer drivlufttryk til håndstykket.

JUSTERING AF DRIVLUFTTRYK (FIG. 3)
Gør det muligt at justere håndstykket til dets producents anbefalede driftstryk. Drej justeringsskruen mod uret for at øge trykket, med uret for at mindske trykket.

JUSTERING AF VANDKØLEVÆSKEFLOW (FIG. 4)
Tillader individuel justering af kølevæske til håndstykkerne. Drej knappen mod uret for at øge flowet, med uret for at mindske flowet.

SKYLNING AF HÅNDSTYKKE (FIG. 5)
Skyller håndstykkets ordontologiske enheds vandledninger (DUWL).

⚠ *ADVARSEL: Se Forest™ Dental Unit Water Line Maintenance Operator's Guide for detaljerede procedurer for vedligeholdelse af DUWL.*

LUFTKØLEVÆSKEFLOWKONTROL (FIG. 6)
Tillader justering af håndstykkerne. Drej knappen mod uret for at øge flowet, med uret for at mindske flowet.

VANDKØLEVÆSKE TIL/FRA (PLACERET PÅ FODRETTEN)
Aktiverer håndstykkets vandkølevæskesystem. Skub kontakten mod den røde prik for at aktivere vandkølingsvæsken.

AUTOMATISK HÅNDSTYKKEHOLDER (FIG. 7)
Signalerer det automatiske kontrolsystem til at tilføre drivluft og luft/vandkølevæske til håndstykket, når det løftes fra dets holder. Når håndstykket sættes tilbage i holderen, stopper et signal til det automatiske styresystem tilførsel af drivluft og luft/vandkølevæske.

DREJELIGE MONTAGEDELE (UNDER HYLDEN) (FIG. 8)
Løsn sætskruen for at justere drejespændingen. Når den er løs, drejes den store møtrik for at justere spændingen. Når den er indstillet korrekt, spændes sætskruen igen for at sikre den ønskede stilling.

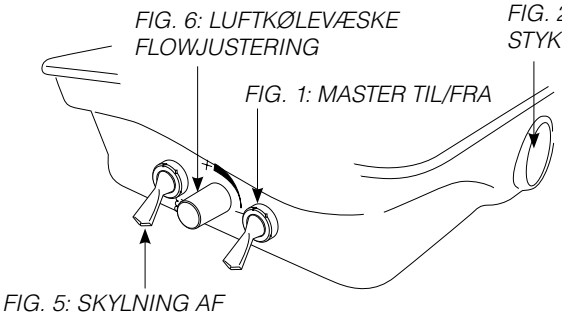

FIG. 5: SKYLNING AF HÅNDSTYKKE

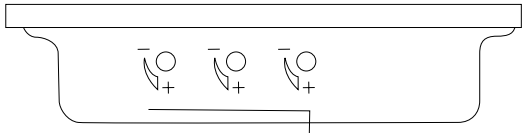

FIG. 3: KØR LUFTTRYKJUSTERING

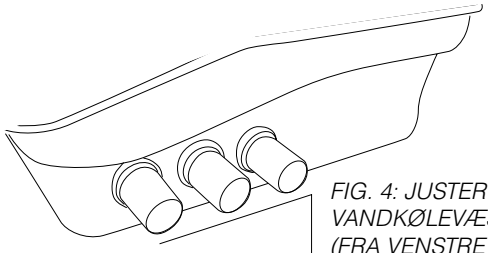

FIG. 4: JUSTERING AF VANDKØLEVÆSKEFLOW (FRA VENSTRE TIL HØJRE 1, 2, 3)

ℹ *BEMÆRK: 2 justeringsknapper i MT610-serien*

FIG 7: AUTOMATISK HÅNDSTYKKEHOLDER (3 PLADSER I MT600-SERIEN) (2 PLADSER I MT610-SERIEN)

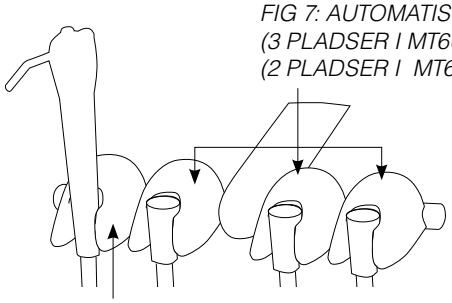

SPRØJTEHOLDER

FIG. 8: DREJELIGE MONTAGEDELE (UNDER HYLDEN)



LØS SÆTSKRUE

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

4.7.21 0097-339 Rev. G