Forest

DENTALEZ

AUTOMATISK BETJENING AF HÅNDSTYKKE

Alle knapper/justeringer er placeret på frontpanelet.

MASTER TIL/FRA (FIG.1)

Tænder for luft og vand for hele systemet. Denne omskifter styrer de luftaktiverede masterventiler i forsyningskassen. Skub kontakten mod On for at aktivere systemet. Sluk altid kontakten, når enheden ikke er i brug.

HÅNDSTYKKETRYKMÅLER (FIG. 2)

Indikerer drivlufttryk til håndstykket.

JUSTERING AF DRIVLUFTTRYK (FIG. 3)

Gør det muligt at justere håndstykket til dets producents anbefalede driftstryk. Drej justeringsskruen mod uret for at øge trykket, med uret for at mindske trykket.

JUSTERING AF VANDKØLEVÆSKEFLOW (FIG. 4)

Tillader individuel justering af kølevæske til håndstykkerne. Drej knappen mod uret for at øge flowet, med uret for at mindske flowet.

SKYLNING AF HÅNDSTYKKE (FIG. 5)

Skyller håndstykkets ordontologiske enheds vandledninger (DUWL).

⚠ *ADVARSEL: Se Forest™ Dental Unit Water Line Maintenance Operator's Guide for detaljerede procedurer for vedligeholdelse af DUWL.*

LUFTKØLEVÆSKEFLOWKONTROL (FIG. 6)

Tillader justering af luftstrømmen til håndstykkerne. Drej knappen mod uret for at øge flowet, med uret for at mindske flowet.

VANDKØLEVÆSKE TIL/FRA (PLACERET PÅ FODRETTEN)

Aktiverer håndstykkets vandkølevæskesystem. Skub kontakten mod den røde prik for at aktivere vandkølingsvæsken.

AUTOMATISK HÅNDSTYKKEHOLDER (FIG. 8)

Signalerer det automatiske kontrolsystem til at levere drivluft og luft/vandkølevæske til håndstykket, når det løftes af holderen. Når håndstykket sættes tilbage i holderen, stopper et signal til det automatiske styresystem tilførsel af drivluft og luft/vandkølevæske.

STOR PANELMONTERING

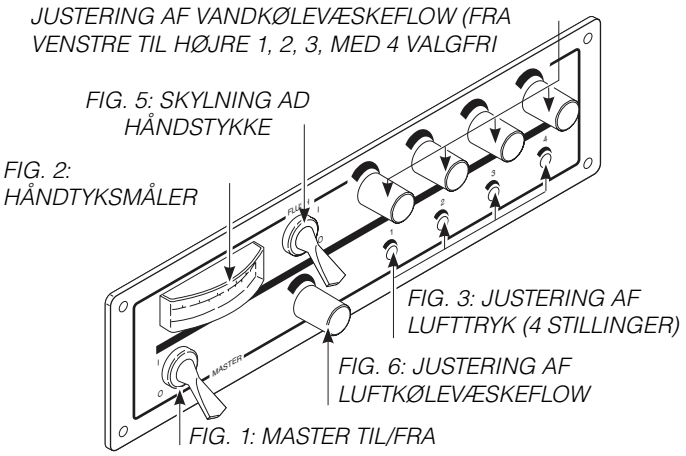

LILLE PANELMONTERING

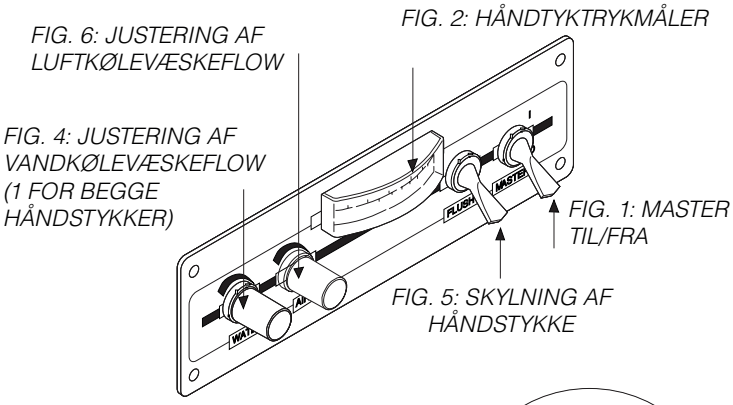



FIG. 3: DRIVLUFTTRYKJUSTERING (2 PLADSER) PLACERET INDE I STELLET

SPRØJTEHOLDER

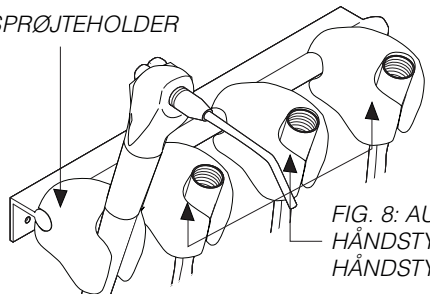

FIG. 8: AUTOMATISK HÅNDSTYKKEHOLDER 2, 3 OG 4 HÅNDSTYKKESTILLINGER

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

4.7.21 0097-509 Rev. D