Forest
DENTALEZ

Se Forest™ Generel Information Operatørvejledning for ordliste over symboler, termer, EMC/elektrisk sikkerhedserklæring og brugervejledning.

INDIKATIONER FOR BRUG/TILSIGTET ANVENDELSE

Tandlægeskamlen er et mekanisk sæde beregnet til tandlægen for bedre adgang til mundhulen under diagnostisk og terapeutisk behandling i et klinisk miljø. Der er ingen kontraindikationer for dette produkt.

⚠ *ADVARSEL: Se Forest Operatory Equipment Asepsis Operator's for overflade- og barrierebeskyttelsesprocedurer.*

⚠ *FORSIGTIG: Føderal lovgivning begrænser denne enhed til salg af eller på ordre fra en tandlæge, der er licenseret af loven i den stat, hvor han/hun praktiserer at bruge eller bestille brug af enheden.*

6156 DOCTOR'S ECONOMY SKAMMEL, 6157 ASSISTENT'S ECONOMY SKAMMEL OG 6160 ASSISTENT'S DELUXE SKAMMEL (FIG. 1)

TRIN 1: Drej knappen til justering af ryglænets højde mod uret for at løsne ryglænet. Når den ønskede position er nået, drej justeringsknappen til ryglænets højde med uret for at låse ryglænet på plads (FIG. 1.1).

TRIN 2: Løft op på højre håndtag for at justere sædehøjden. Slip håndtaget for at låse på plads (FIG. 1.2).

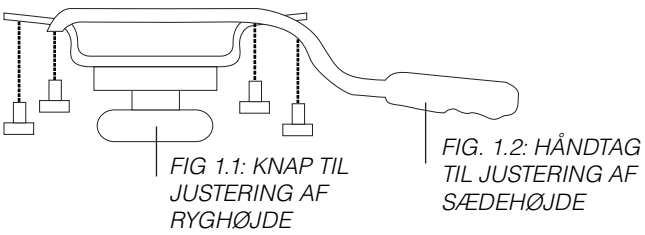

FIG 1.1: KNAP TIL JUSTERING AF RYGHØJDE

FIG. 1.2: HÅNDTAG TIL JUSTERING AF SÆDEHØJDE

UNDER SÆDE

6159 DOCTOR'S DELUXE SKAMMEL OG 6161 ASSISTENT'S DELUXE SKAMMEL (FIG. 2)

TRIN 1: Løft det forreste højre håndtag for at justere sædehøjden (FIG. 2.1).

TRIN 2: Løft det bagerste højre håndtag for at justere sædets hældning (FIG. 2.2).

TRIN 3: Drej knappen til justering af ryglænets højde mod uret for at løsne ryglænet. Når den ønskede højde er nået, drejes justeringsknappen til ryglænets højde med uret for at låse ryglænet på plads (FIG. 2.3).

TRIN 4: Løft venstre håndtag for at justere ryglænets hældning. Skub venstre håndtag ned, indtil håndtaget låser på plads for at aktivere det frit flydende ryglæn (FIG. 2.4).

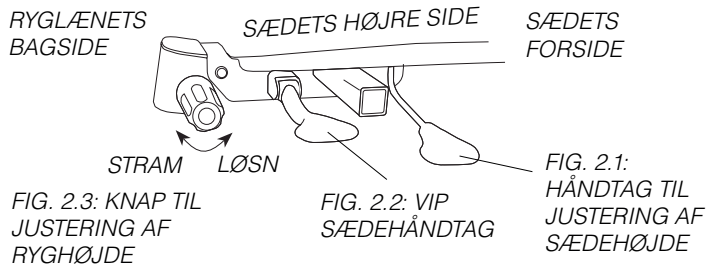

FIG. 2.3: KNAP TIL JUSTERING AF RYGHØJDE

FIG. 2.2: VIP SÆDEHÅNDTAG

FIG. 2.1: HÅNDTAG TIL JUSTERING AF SÆDEHØJDE

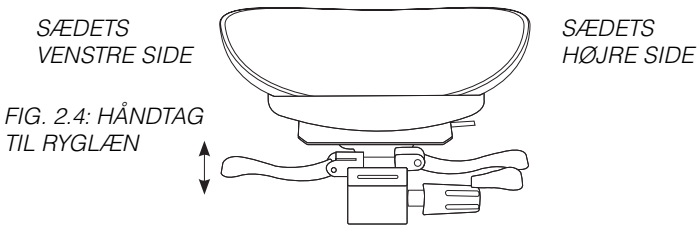

FIG. 2.4: HÅNDTAG TIL RYGLÆN

6160 OG 6161 ASSISTENT'S DELUXE SKAMMEL (FIG.3)

TRIN 1: Juster højden af armen til torsostøtte ved at dreje justeringsknappen mod uret for at løsne og med uret for at fastspænde igen (FIG. 3.1).

TRIN 2: Drej løftearmshåndtaget i den retning, du ønsker, at armen skal bevæge sig (FIG. 3.2).



FIG. 3.1: JUSTERINGSKNAP



FIG. 3.2: LLØFTEARMS-HÅNDTAG

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715