JALKAKÄYNNISTIMEN ASENNUS

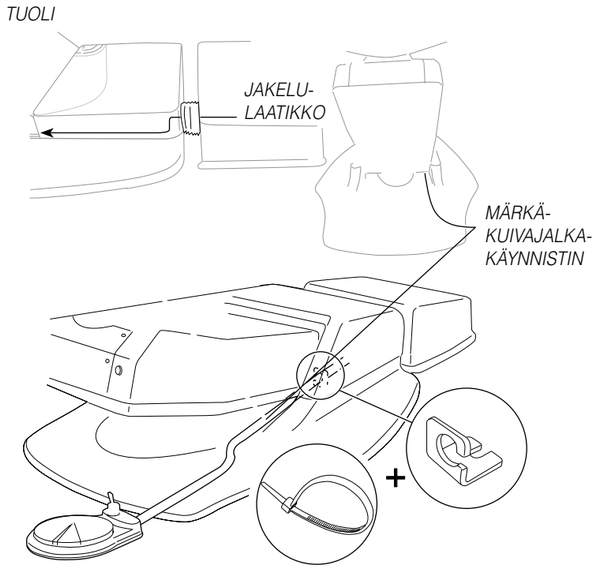

HUOMIO: Lue lisää putkien liitännöistä Jakelu- ja jalkakäynnistinkaaviosta.

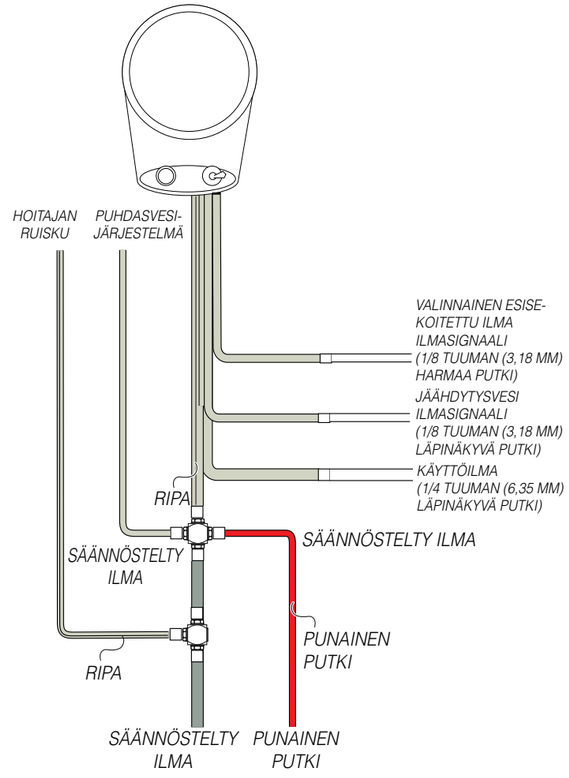

PUTKIEN JA JOHTOJEN REITITYS JAKELUKESKUKSEEN

VAIHE 1: Reititä putket ja johdot joustekierreputkea pitkin jakelukeskukseen (KUVAT 1–1.2).

VAIHE 2: Asenna tuolin kannet uudelleen seuraamalla sivujen 1 ja 2 ohjeita 1–11 käänteisessä järjestyksessä.

KUVA 1:

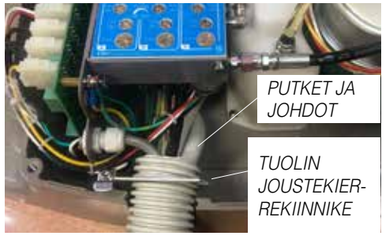

KUVA 1.2:

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

6.10.21 0097-081 Versio A 4/4

FUSION KÄÄNTYVÄ HOITOYKSIKKÖJÄRJESTELMÄ

Forest DENTALEZ

ASENNUSOHJE

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.

HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Vältä staattisten purkausten aiheuttamia vahinkoja elektroniikkalaitteille käyttämällä aina maadoitussovittimeen (esim. banaani- tai maadoitusliittimeen) kiinnitettyä maadoitettua ranneketta piirilevyjä, tuolin ohjaimia tai kaapeleita käsitellessä ja virtapiirien alueella työskennellessä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest™-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.

HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.

Tarvittavat työkalut: Tuuma- ja metrimittainen kuusiokoloavainsarja, momenttiavain ja hylsyjä, ruuviavainsarja, uraruuvitaltta ja nitriilikäsineet.

TUOLIN KANSIEN IRROTTAMINEN

VAIHE 1: Aseta tuolin selkänoja ja alusta täyteen yläasentoon.

VAIHE 2: Irrota tuoli verkkovirrasta.

VAIHE 3: Poista pumpun kannen kyljen ruuvit (2) 1/8 tuuman (3,18 mm) kuusiokoloavaimella (KUVA 1).

VAIHE 4: Nosta takakulmaa ja liu'uta pumpun kantta eteenpäin irrottaaksesi listat kiinnikkeistä ja poista kansi (KUVAT 2–2.1).

VAIHE 5: Poista takasivukannet (2) kääntämällä niitä vastapäivään ja aseta syrjään (KUVA 3).

HUOMIO: Ohita vaiheet 5–11, jos tuolin putket on esiasennettu ja katso Fusion kääntyvän tuolin sovittimen ja hoitoyksikkö- ja valovarsien asennusohjeesta ohjeet hoitoyksikkö- ja valovarsien asennukseen.

VAIHE 6: Nosta kannattimen yläkansi tuolin nostimen rungosta (KUVA 4–4.1).

VAIHE 7: Irrota merkkivalon johtoliitin painamalla puristinta (KUVAT 5–5.1).

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Merkkivaloon on kytketty johto. Älä poista kantta kokonaan ennen vaihetta 7.

KUVA 1:

KUVA 2:

KUVA 2.1:

KUVA 3:

KUVA 4:

KUVA 4.1:

KUVA 5:

KUVA 5.1:



TUOLIN KANSIEN IRROTTAMINEN (JATKUU)

VAIHE 8: Poista sivukansien ruuvit (2) 5/32 tuuman (3,97 mm) kuusiokoloavaimella (KUVA 6).

VAIHE 9: Irrota ylempi takakansi (KUVA 7).

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Muistipainikkeeseen on kytketty johto. Älä poista kantta kokonaan ennen seuraavaa vaihetta.*

VAIHE 10: Irrota muistipainikkeen johtoliitin painamalla puristinta. Irrota ylempi takakansi (KUVA 8).

VAIHE 11: Levitä suojavasteen kantta molemmin käsin ja vedä sitä ulommas nostaaksesi sen pulttien yli (KUVA 8.1).

KUVA 6:

KUVA 7:

KUVA 8:



KUVA 8.1:

TUOLIN KOONTIJOHDON ASENNUS

VAIHE 1: Reititä koontijohto solenoidisarjan ja hydraulinestesäiliön välistä (KUVA 1).

VAIHE 2: Reititä koontijohto ylös nostimen runkoon (KUVA 2).

VAIHE 3: Reititä koontijohto koontijohdon ohjainten läpi (KUVA 3).

VAIHE 4: Reititä koontijohto tuolin selkäpuolin läpi tuolin valokseen (KUVA 4).

VAIHE 5: Reititä koontijohto tuolin valoksesta ylös tuolin sovittimeen (KUVA 5).

VAIHE 6: Syötä koontijohto tuolin sovittimen alemman aukon läpi. Reititä läpi, ylös ja ulos koontijohdon aukosta (KUVA 6).

KUVA 1:

KUVA 2:

KUVA 3:

KUVA 4:



KUVA 5:

KUVA 6:

HOITOYKSIKÖN JOUSTOVARREN ASENNUS

VAIHE 1: Asenna hoitoyksikön joustovarsi ja reititä samalla koontijohto joustovarresta kääntyvän hoitoyksikkövarren läpi ja ulos tuolin istuimesta.

❗ *HUOMIO: Kun asennat joustovartta, varmista, että vasterenkaan ura on suunnattu poispäin tuolista ja vastetapin yläpuolelle.*

VAIHE 2: Jos tarpeellista, reititä ohjainyläkappaleeseen kiinnitetyn hoitajan hoitoyksikön nesteenpoisto-/imujohto hoitoyksikön kääntövarren aukkoon ja ulos tuolin istuimen alta.

KUVA 2:

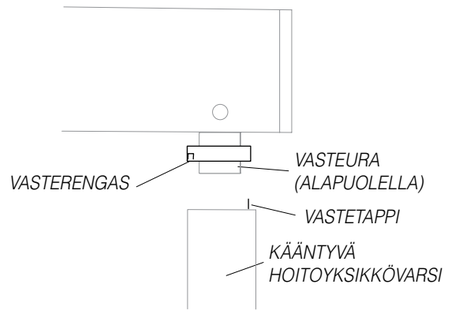

KOONTIJOHDON PUTKI- JA JOHTOLIITOKSET

VAIHE 1: Yhdistä toisiinsa sopivat numerot ja värit koontijohdon putkiin ja johtoihin asennetuilla liittimillä (KUVA 1).

VAIHE 2: Yhdistä valo-/monitorikaapeliliitin (KUVA 2).

VAIHE 3: Peitä koontijohdon putket ja johdot kaapelien verkkosuojuksella (KUVA 2).

KUVA 1:

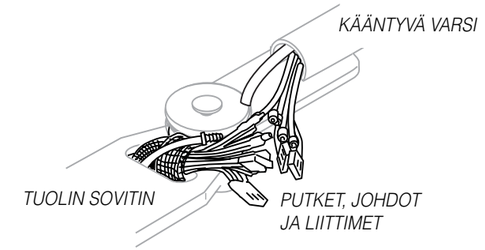

KUVA 2:

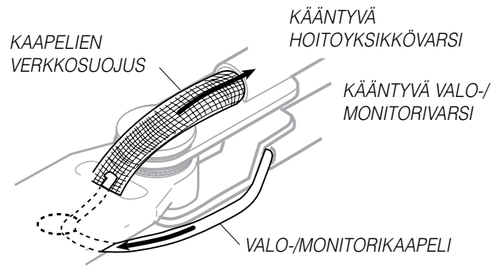
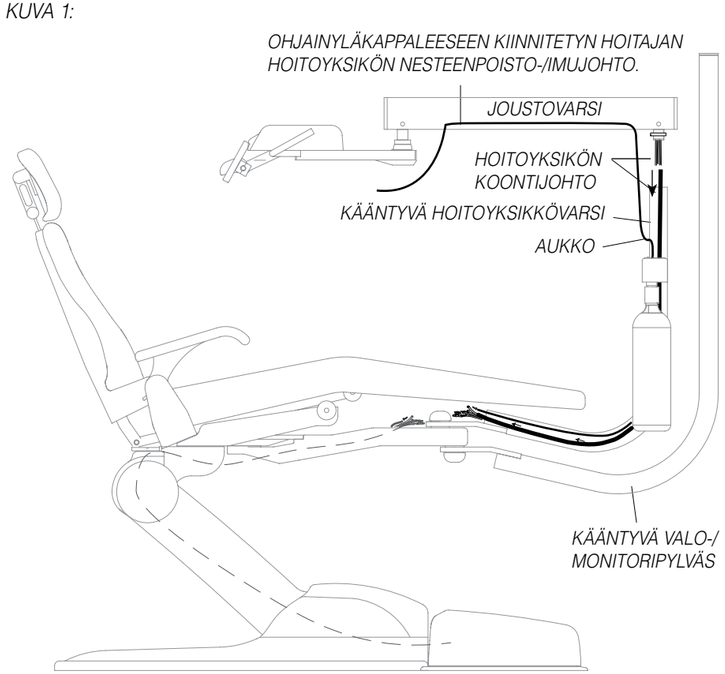
KUVA 1: