VALINNAINEN TAITTOVARSIKIINNITYS (1110-115)

Tarvittavat työkalut: 5/16 tuuman (7,94 mm) ja 7/32 tuuman (3,97 mm)
Suositellut kiinnitystarvikkeet: 10-32 x 3/4" (19,06 mm) kuusiokoloruuvi, ruostumaton teräs, 4 kpl

VAIHE 1: Asenna pystykiinnityslaatta seinään tai kaappiin (KUVA 1).

KUVA 1:

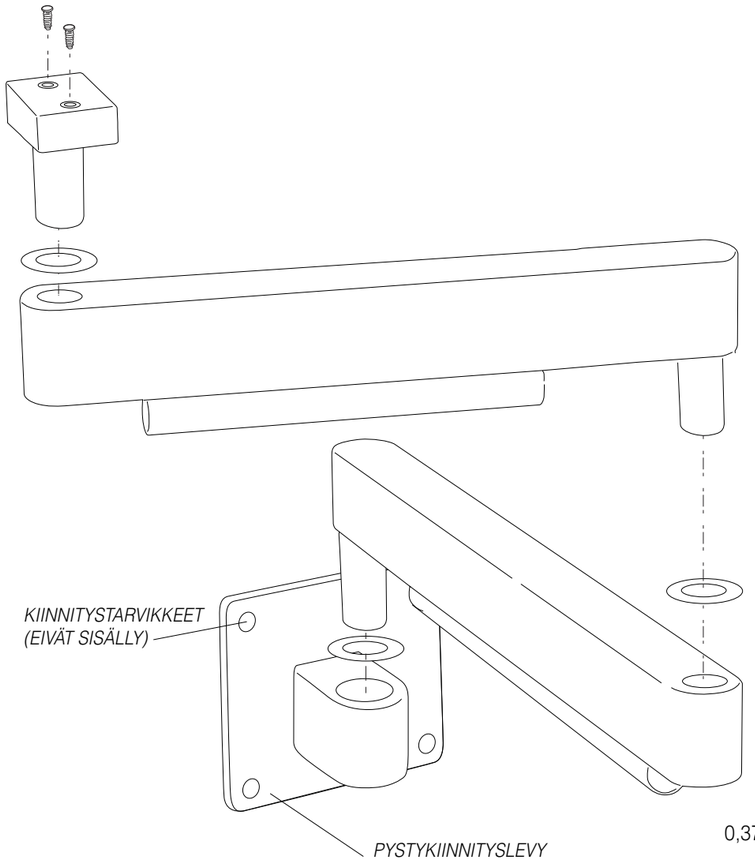

PYSTYKIINNITYSLAATAN MITAT

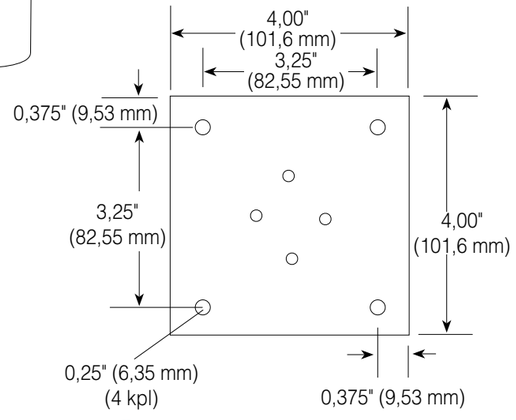

HUOMIO: Ei mittakaavassa.

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

TAKA-/SIVUKIINNITTEINEN KAAPPI-/SEINÄHOITOYKSIKKÖ

Forest DENTALEZ

ASENNUSOHJE

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.

HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.

VAROITUS: Suosittelemme neuvojen kysymistä pätevältä ammattilaiselta, eli rakennusinsinööriltä, kun hoitoyksikkö kiinnitetään rakennuksen rakenteisiin. Jos hoitoyksikkö asennetaan kaappiin, hyllyyn tai muuhun huonekaluun, varmista erityisen tarkasti, että laite on ehjä ja turvallisesti kiinni rakennuksen rakenteissa ja kestää hoitoyksikön painon ilman että se irtoaa tai taipuu alas, mikä voi aiheuttaa vammoja. Forest™ ei vastaa virheellisten asennusten aiheuttamista vahingoista.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Suositellut ja toimitetut kiinnitystavarat eivät välttämättä sovi kaikkiin asennuksiin. Vältä mahdollisia vahinkoja valitsemalla kiinnitystavarat varovaisesti. Forest ei ole vastuussa kiinnitystavaravalintojen aiheuttamista vahingoista.

HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.

KAAPPI- JA SEINÄKIINNITTEINEN SIVUHOITOYKSIKKÖ (1110-376)

Mukana toimitetut kiinnitystarvikkeet: 3/8-16" (35,56 cm) x 1" (2,54 cm) kupukantainen kuusiokoloruuvi 18-8 ruostumaton teräs, 4 kpl; 3/8-16" (35,56 cm) x 7/16" (1,11 cm) t-mutteri, 4 piikkiä, sinkki, 4 kpl.

HUOMIO: Valitse asennuspaikka seuraavien vaatimusten perusteella: Yksikön varren ulottuvuus, jotta käyttäjä voi asemoida hoitoyksikön mahdollisimman joustavasti. Kiinteän varren, varren navan ja mahdollisten esteiden välit. Hoitoyksikön ilman-, veden- ja sähkönsyötön sijainti.

HUOMIO: Navan laakeriholkki, yläpylväskiinnitys, 2,502 ± 0,002 sisähalkaisija.

HUOMIO: 14 tuuman (35,56 cm) kiinnityskorkeus lattiasta tarkoittaa, että hoitoyksikön työtason korkeus lattiasta on 15,25–34,25 tuumaa (38,74–87 cm) tavalliselle IC-ohjaimelle ja 16–35 tuumaa (40,6–89 cm) arvo-ohjaimelle. Varmista lopullisen asennuksen sopivuus lääkäriltä.

VAIHE 1: Asenna tasoitus- ja kiinnityslevyt seinään tai kaappiin (KUVA 1).

KUVA 1:

PYSTYKIINNITYSLAATAN MITAT

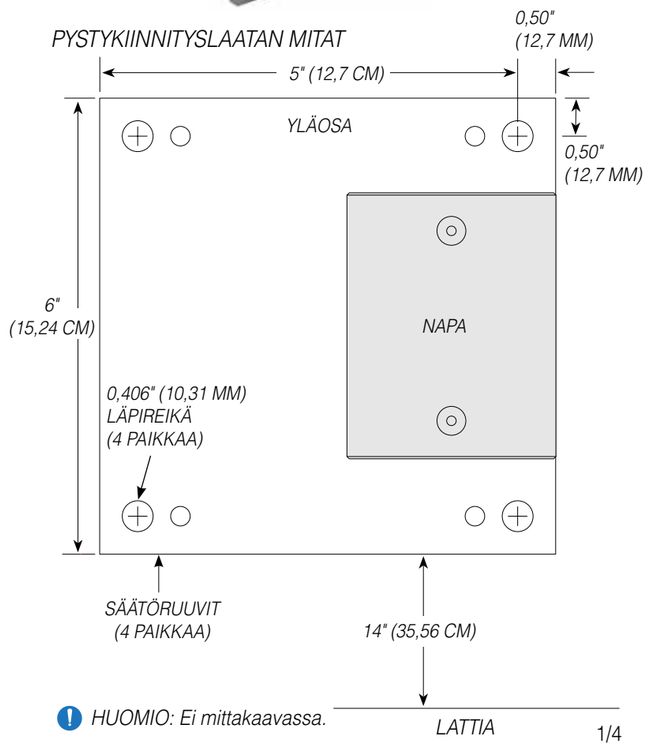

HUOMIO: Ei mittakaavassa.

MT-YLÄHYLLYKIINNITYS

Tarvittavat työkalut: Ristipääruuvitaltta, mittanauha

HUOMIO: Määritä kiinnityspaikka (MT: n alaosa ei erkane pinnasta).

VAIHE 1: Kiinnitä MT-runko kaappi-/hyllytason päälle 2 ruuvilla (KUVA 1).

HUOMIO: Kiinnitystarvikkeet eivät sisälly.

KUVA 1:

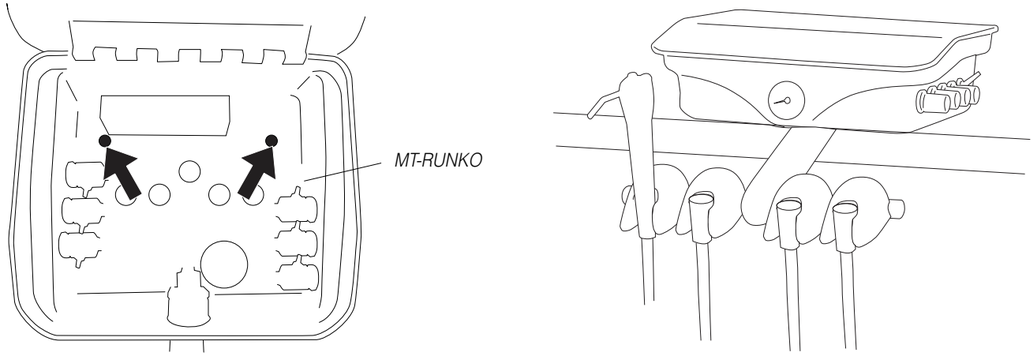

HYLLYNALINEN KÄÄNTYVÄ KIINNITYS (1700-150)

Tarvittavat työkalut: 3/32 tuuman (2,38 mm) ja 1 tuuman (25,4 mm) kuusiokoloavain.
Suositellut kiinnitystarvikkeet: #10 x 3/4" (4,83 x 19,05 mm) matalakupukantainen muovaava kierteittävä ristipääruuvi, 4 kpl.

VAIHE 1: Asenna kääntökiinnityslevy kaappi-/hyllytason alle (KUVA 1).

KUVA 1:

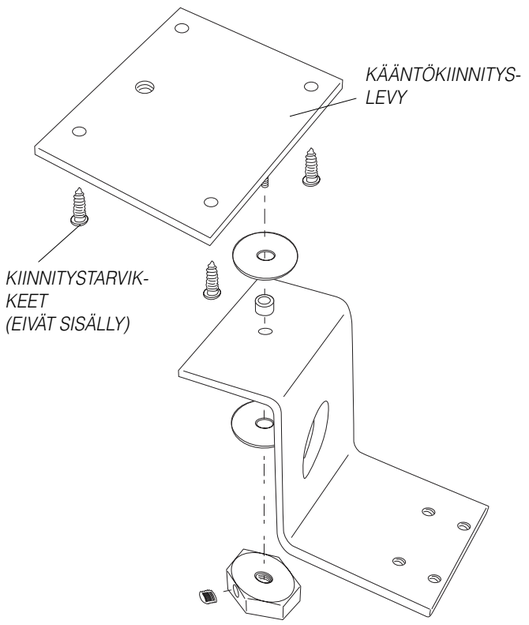

KÄÄNTÖKIINNITYSLEVYN MITAT

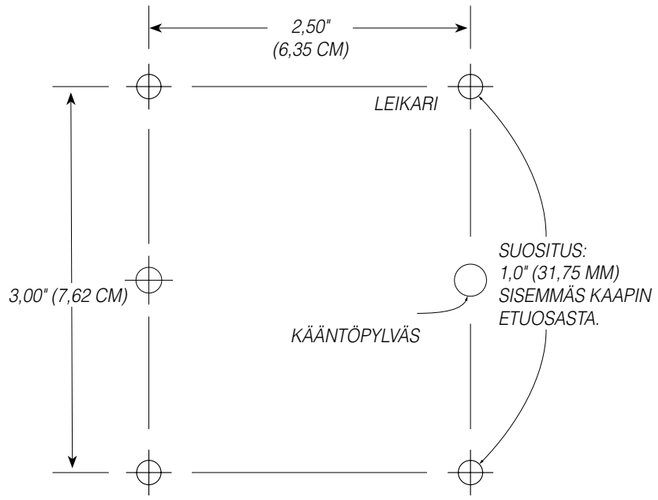

HUOMIO: Ei mittakaavassa.

VALINNAINEN HYLLYALINEN LIUKU-/KÄÄNTÖKIINNITYS (1700-140/1700-142)

Tarvittavat työkalut: 3/32 tuuman (2,38 mm) ja 1 tuuman (25,4 mm) kuusiokoloavain.
Suositellut kiinnitystarvikkeet: #8 x 1" (4,12 x 25,4 mm) matalakupukantainen muovaava kierteittävä ristipääruuvi, 6 kpl.

VAIHE 1: Kiinnitä MT-runko kaappi-/hyllytason päälle 2 ruuvilla (KUVA 1).

KUVA 1:

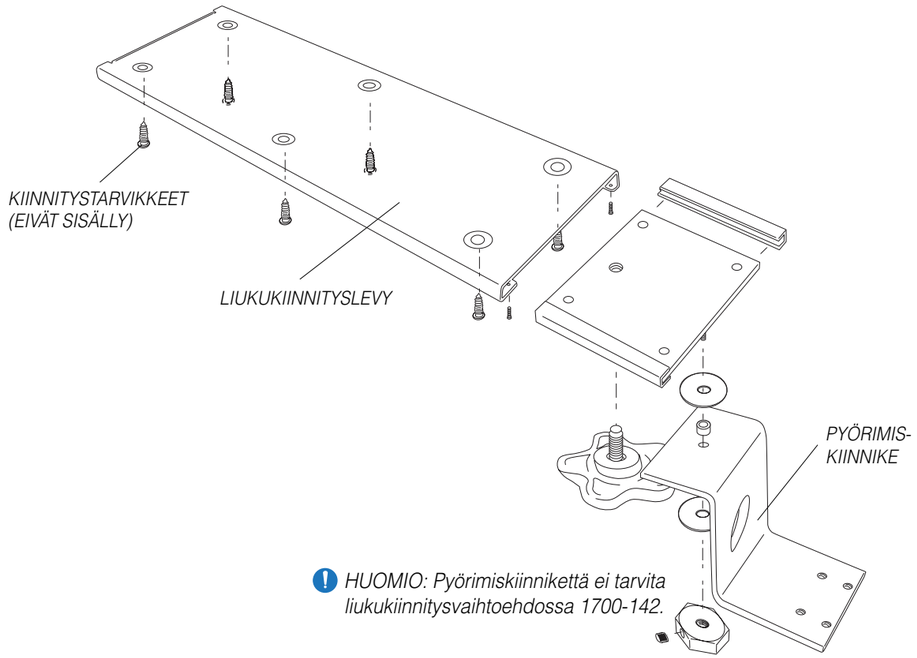

HUOMIO: Pyörimiskiinnikettä ei tarvita liukukiinnitysvaihtoehdossa 1700-142.

LIUKUKIINNITYSLEVYN MITAT

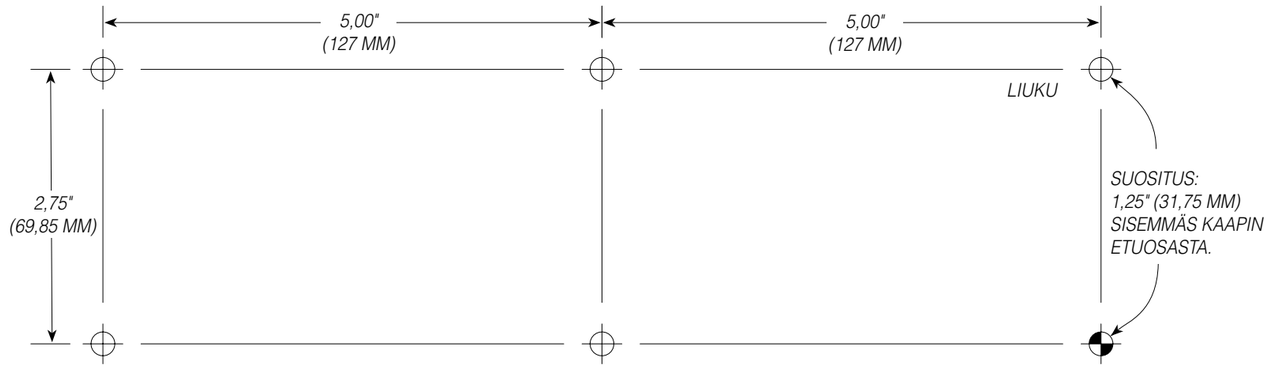

HUOMIO: Ei mittakaavassa.