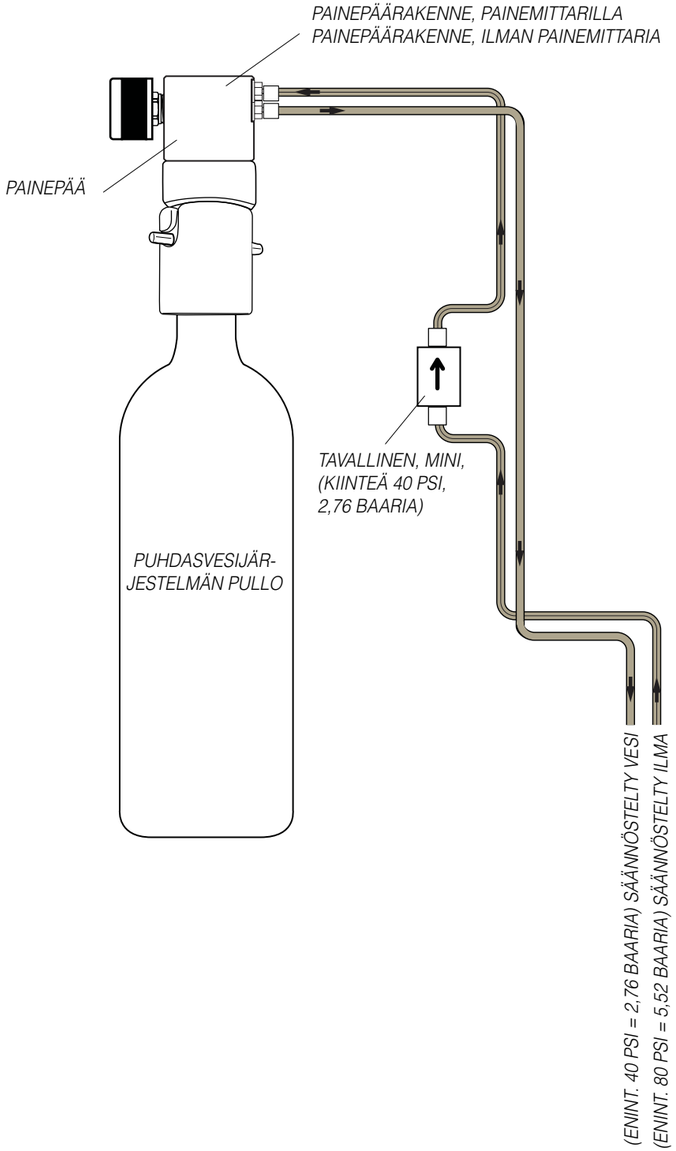

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM
6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459

PUHDASVESIJÄRJESTELMÄ

Forest
DENTALEZ

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

⚠ *VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.*

❗ *HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Forest™-tuotteiden sähköiseen ja/tai mekaaniseen turvallisuuteen vaikuttavat asennuksen jälkeiset muunnokset ovat ristiriidassa yhtiön asennusvaatimusten kanssa, eikä Forest anna niihin lupaa.*

❗ *HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.*

KIINTEÄ TUOLIKIINNITYS ILMAN SIVULAATIKKOA – SISÄINEN KOONTIJOHTO

Tarvittavat työkalut: 5/64 tuuman (1,98 mm) ja 3/16 tuuman (4,76 mm) kuusiokoloavain

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Vesi- ja ilmaliitännät: Hoitoyksikön vesijohdot on suunniteltu liitettäväksi vesijärjestelmiin, joissa on takaisinvirtauksen estin ja enintään 90 µm: n verkolla varustettu pienhiukkassuodatin sekä ilmajohtoihin, joissa on enintään 25 µm: n verkolla varustettu pienhiukkassuodatin.*

VAIHE 1: Käytä puhdasvesinjärjestelmän kiinnittämiseen merkittyä mittausta (KUVA 1).

VAIHE 2: Liitä puhdasvesijärjestelmä pylvääseen ja reititä putket aukon kautta pylvääseen (KUVA 2).

VAIHE 3: Yhdistä vastaavat putket yksikön koontijohtoon (KUVA 3).

VAIHE 4: Asenna pullo (KUVA 4).

KUVA 1:



KUVA 2:

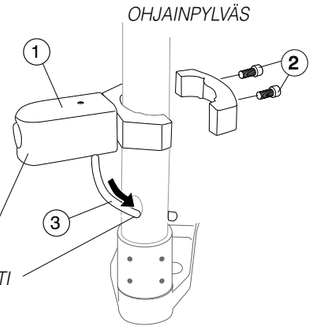

KUVA 3:



KUVA 4:

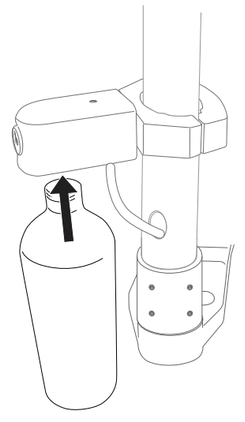

KÄÄNTYVÄ OHJAINPYLVÄS – SISÄINEN KOONTIJOHTO

Tarvittavat työkalut: 5/32 tuuman (3,97 mm) kuusiokoloavain

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Vesi- ja ilmaliitännät: Hoitoyksikön vesijohdot on suunniteltu liitettäväksi vesijärjestelmiin, joissa on takaisinvirtauksen estin ja enintään 90 µm: n verkolla varustettu pienhiukkassuodatin sekä ilmajohtoihin, joissa on enintään 25 µm: n verkolla varustettu pienhiukkassuodatin.*

VAIHE 1: Asenna kokooja pylvääseen sopivilla ruuveilla (2) ja reititä putket pylvään läpi (KUVA 1).

VAIHE 2: Yhdistä vastaavat putket yksikön koontijohtoon (KUVA 2).

VAIHE 3: Asenna pullo (KUVA 3).

KUVA 1:

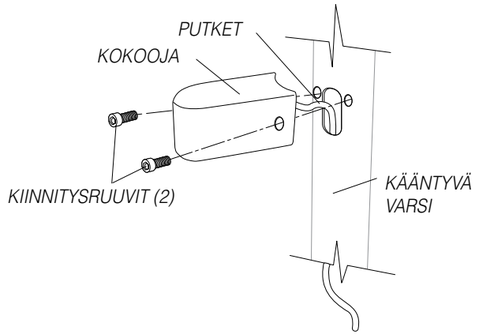

KUVA 2:

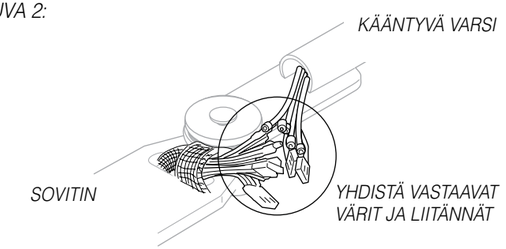

KUVA 3:

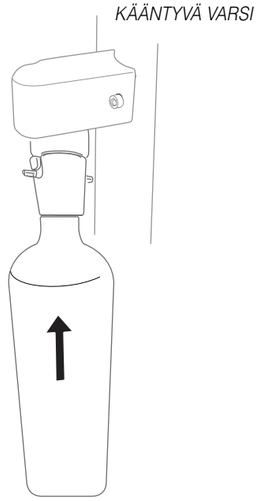

PIKALIITÄNTÄRAKENTEET

ℹ *HUOMIO: Kierteenlukitusaine on suunniteltu sallimaan pullon poisto sovittimesta. Sitä ei ole suunniteltu pysyväksi. Poista sovittimesta liiallinen kierteenlukitusaine uudelleenasennuksen yhteydessä.*

PULLON MUUNTIMEN ASETTAMINEN PAINEPÄÄHÄN:

VAIHE 1: Poista vesipullo painepäästä (KUVA 1).

VAIHE 2: Levitä pieni pallo kierteenlukitusainetta muuntimen 2 kokonaiseen kierteeseen ja kierrä painepäähän (KUVA 2).

VAIHE 3: Anna kovettua 30 minuuttia.

VAIHE 4: Asenna pikaliitäntäsovittimellinen pullo muuntimeen ja kiinnitä kääntämällä (KUVA 3).

PIKALIITINSOVITTIMEN KIINNITTÄMINEN PULLOON:

VAIHE 1: Levitä pieni pallo kierteenlukitusainetta pikaliitäntäsovittimen 2 kokonaiseen kierteeseen ja kierrä pullon kierteisiin (KUVA 2).

VAIHE 2: Anna kovettua 30 minuuttia.

VAIHE 3: Asenna pikaliitäntäsovittimellinen pullo muuntimeen ja kiinnitä kääntämällä (KUVA 3).

KUVA 1:

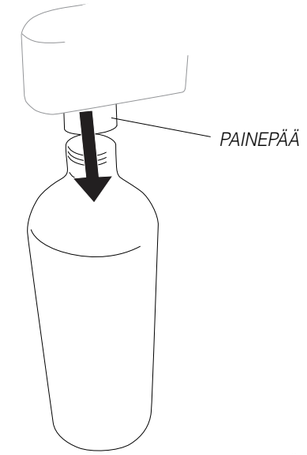

KUVA 2:

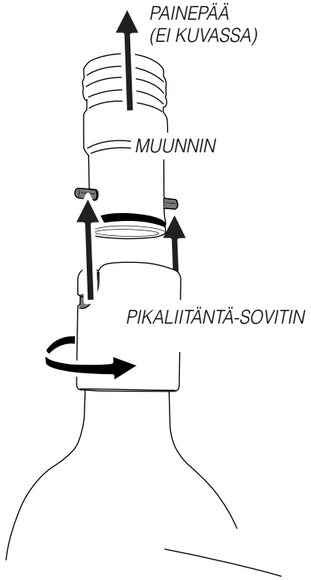
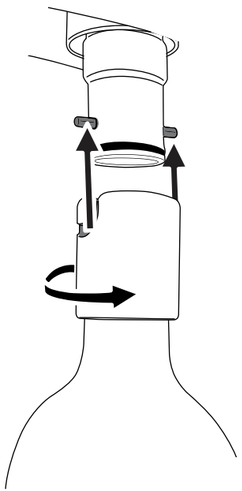
KUVA 3: