Forest
DENTALEZ

HUOMIOSYMBOLIEN SELITYS

Seuraaviin merkkeihin liittyvät turvallisuushuomautukset on huomioitava erityisesti oppaan huolto-, käyttö- ja hätätilannetoimenpiteissä.

⚠ *VAROITUS tarkoittaa, että VAROITUKSEN huomiotta jättäminen saattaa vaarantaa potilaan, loppukäyttäjän tai teknikon henkilöturvallisuuden. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa vamman.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS tarkoittaa, että tiettyä toimenpidettä tai varotoimea on noudatettava järjestelmän virheiden ja tuotteen mahdollisen vahingoittumisen estämiseksi.*

❗ *HUOMIO tarkoittaa erityisiä tietoja, joilla helpotetaan tuotteen asennusta tai huoltoa tai selvennetään tärkeitä seikkoja.*

⚠ *VAROITUS: Kiinnitä korkeudensäätösylinterin sisäinen mäntä vasta kun jakkara on koottu. Männän käyttäminen ennen asennusta saattaa aiheuttaa vamman.*

❗ *HUOMIO: Asennuksen tarkistaminen: Katso käyttäjän opas ja kokeile kaikkia toimintoja. Jos kaikki toimii halutusti, asennus on valmis. Jos toiminnot eivät toimi halutusti, varmista että asennus on tehty oikein ASENNUSOHJEITA noudattaen tai soita tekniseen tukeen numeroon 800-423-3555.*

6176 LÄÄKÄRIN MUKAVUUSJAKKARA

VAIHE 1: Kiinnitä rullapyörät jalkaan. Paina huomattavan kovaa, jotta rullapyörät asettuvat varmasti paikoilleen (KUVAT 1–2).

KUVA 5: KOOTTU SELKÄNOJA



KUVA 2: ALUMIINIJALKA



KUVA 4: KOOTTU ISTUIN



KUVA 3: KORKEUDEN SÄÄTÖ-SYLINTERI



KUVA 1: RULLAPYÖRÄT

VAIHE 2: Työnnä alumiinijalkaan korkeudensäätösylinteri (KUVA 3).

VAIHE 3: Asenna koottu istuin korkeudensäätösylinterin päälle (KUVA 4).

VAIHE 4: Poista musta tulppa ja työnnä koottu selkänoja koottuun istuimeen. Palauta musta tulppa paikalleen asennuksen jälkeen (KUVA 5).

VAIHE 5: Lukitse sylinteri jalkaan ja istuimeen pysyvästi istumalla jakkaran päälle. Nyt korkeudensäätösylinterin männän voi kiinnittää aktivoimalla istuimen korkeudensäätövivun ja istuinta säätämällä.

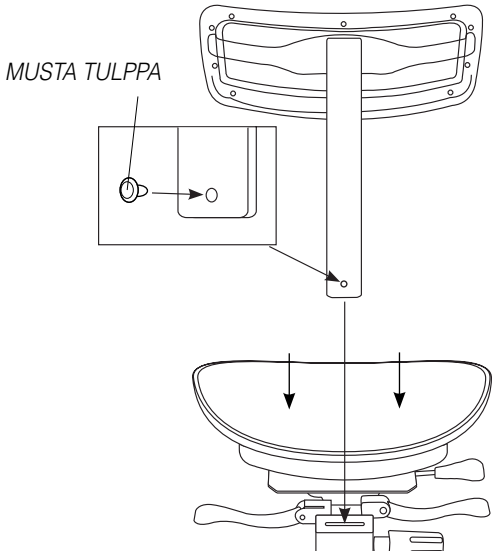

⚠ *VAROITUS: Kun työnnät korkeudensäätösylinterin sisään, varo, etteivät sormesi jää puristuksiin.*

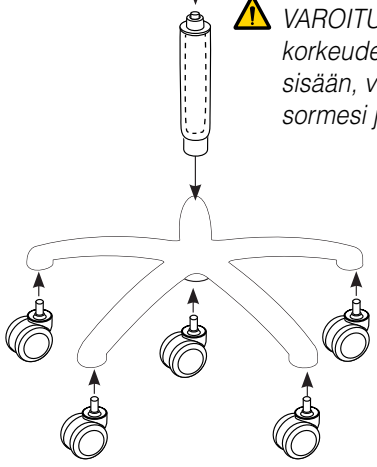

⚠ *VAROITUS: Varmista, että rullapyörät ovat tukevasti kiinni ennen jakkaran käyttämistä.*

6187 HOITAJAN MUKAVUUSJAKKARA

VAIHE 1: Kiinnitä rullapyörät jalkaan. Paina huomattavan kovaa, jotta rullapyörät asettuvat varmasti paikoilleen (KUVAT 1–2).

VAIHE 2: Työnnä jalkaan korkeudensäätösylinteri (KUVA 3).

VAIHE 3: Liu'uta säädettävä jalkatuki korkeudensäätösylinterin päälle ja kiristä jalkatuki jalkatuen nupilla (KUVA 4).

VAIHE 4: Liu'uta kromivarsiputki korkeudensäätösylinterin päälle niin, että se asettuu tukevasti (KUVA 5).

VAIHE 5: Asenna koottu istuin korkeudensäätösylinterin päälle (KUVA 6).

VAIHE 6: Poista musta tulppa ja työnnä koottu selkänoja koottuun istuimeen. Palauta musta tulppa paikalleen asennuksen jälkeen (KUVA 7).

VAIHE 7: Liu'uta räikkäkäsinoja varsiputkeen. Kiristä varsi tiukasti paikoilleen kääntämällä varsiputken nuppia myötäpäivään (KUVA 8).

VAIHE 8: Lukitse sylinteri jalkaan ja istuimeen pysyvästi istumalla jakkaran päälle. Nyt korkeudensäätösylinterin männän voi kiinnittää aktivoimalla istuimen korkeudensäätövivun ja istuinta säätämällä.



KUVA 8: RÄIKKÄKÄSINOJA



KUVA 7: SELKÄNOJAN RAKENNE



KUVA 6: ISTUIMEN RAKENNE



KUVA 5: KROMIVARSIPUTKI



KUVA 4: SÄÄDETTÄVÄ JALKATUKI

KUVA 3: KORKEUDENSÄÄTÖSYLINTERI



KUVA 2: ALUMIINIJALKA



KUVA 1: RULLAPYÖRÄT

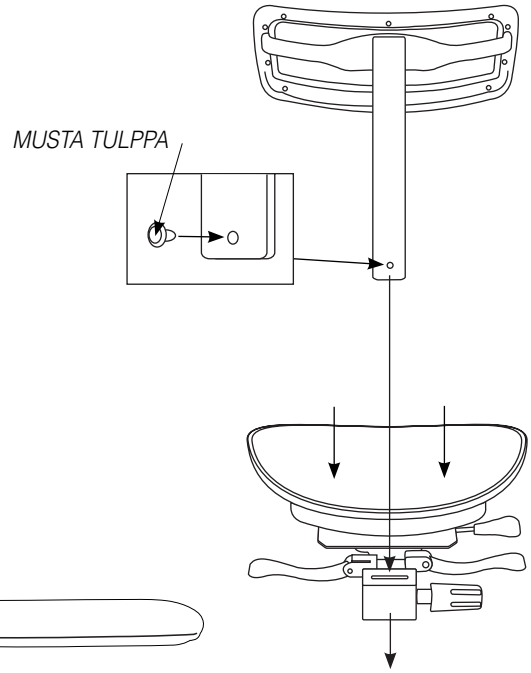

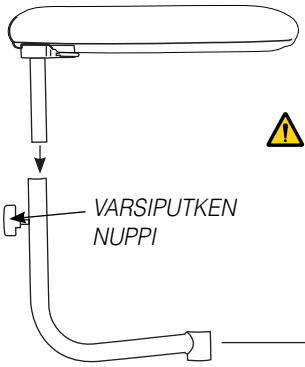

⚠ *VAROITUS: Varmista, että varsiputken ja jalkatuen säätönupit on kiristetty huolellisesti (kääntämällä myötäpäivään). Lipsuminen voi aiheuttaa vamman.*

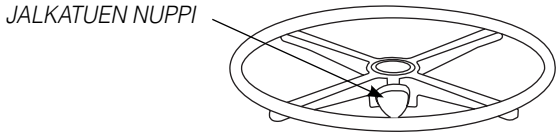

⚠ *VAROITUS: Kun työnnät korkeudensäätösylinterin sisään, varo, etteivät sormesi jää puristuksiin.*

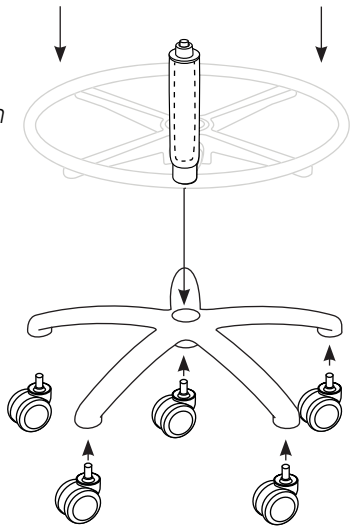

⚠ *VAROITUS: Varmista, että rullapyörät ovat tukevasti kiinni ennen jakkaran käyttämistä.*

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE