Forest
DENTALEZ

## LOKETNÍ OPĚRKA

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Pro minimalizaci možného zranění pacienta je křeslo vybaveno pohyblivými loketními opěrkami umožňujícími snadnější nasedání/vysedání. Na začátku a na konci návštěvy nezapomeňte pro pacienta snížit loketní opěrku (pro snadnější nasedání/vysedání). Loketní opěrky nejsou určeny k tomu, aby se o ně pacient při nasedání či vysedání z křesla opíral svou hmotností.*

*KROK 1:* Chcete-li loketní opěrku snížit, zatáhněte za páku ramene nacházející se na zadní straně sestavy ramene (OBR. 8).

*KROK 2:* Chcete-li loketní opěrku zvýšit, zvyšte snížený konec loketní opěrky, dokud se loketní opěrka nezastaví a nezacvakne do uzamykací pozice loketní opěrky.

*OBR. 8: PÁKA RAMENE*

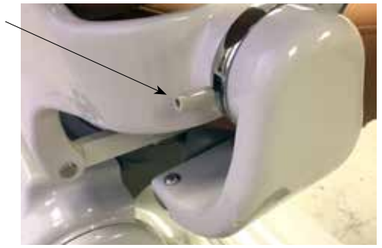

## NASTAVENÍ POSUNU TUHOSTI OPĚRKY HLAVY

*KROK 1:* Odeberte vycpání opěrky zad (OBR. 9).

*KROK 2:* Nastavte šrouby (OBR. 10).

*KROK 3:* Nahraďte vycpání opěrky zad (OBR.11)

POTŘEBNÉ NÁSTROJE: Křížový šroubovák

*OBR. 9: ZÁDOVÁ OPĚRKA*

*OBR. 10: ŠROUBY*

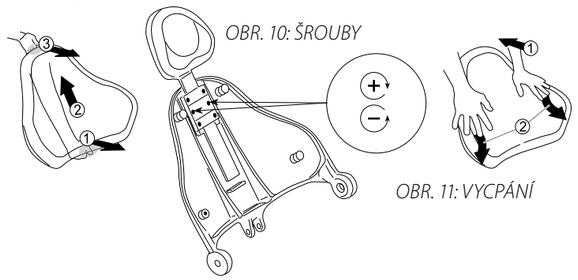


*OBR. 11: VYCPÁNÍ*

## PÉČE O ČALOUNĚNÍ

⚠ *VAROVÁNÍ: Vždy si přečtěte pokyny výrobce dezinfekčního prostředku, abyste se ujistili, že prostředek není škodlivý pro lidi nebo materiály, s nimiž přichází do styku. Další pokyny pro čištění a dezinfekci povrchů v okolním prostředí naleznete v provozní příručce asepse provozního zařízení Forest™. Další informace o kontrole infekcí naleznete zde:*

Pokyny pro kontrolu infekcí na dentálních pracovištích na webu: www.cdc.gov.

Doporučení Americké asociace dentistů naleznete na webu: www.ada.org

Doporučení Organizace bezpečnostních a aseptických postupů naleznete na webu www.osap.org.

⚠ *VAROVÁNÍ: Dodržujte varování výrobce. Společnost Forest nebo výrobce čalounění nemohou nést odpovědnost za škody nebo zranění plynoucí z použití nebo nesprávného použití jakýchkoli čisticích prostředků. Čisticí prostředky mohou obsahovat drsná nebo neznámá rozpouštědla; také podléhají změnám složení provedeným výrobcem bez upozornění. Pokud používáte jiné než popsané čisticí přípravky, důrazně doporučujeme, abyste je nejprve vyzkoušeli na nenápadném místě, abyste se ujistili, že nepoškodí čalounění, plastové nebo kovové povrchy.*

Správná údržba a pravidelné čištění zabrání nadměrnému hromadění nečistot. Chcete-li, aby kvalitní tkanina vypadala co nejlépe, dodržujte tyto pokyny. S jejich pomocí prodloužíte životnost tkaniny Naugahyde®.

## LEHKÉ ZAŠPINĚNÍ

*KROK 1:* Většinu nečistot odstraní roztok 10% jemného mýdla a teplé vody nanesený měkkým vlhkým hadříkem.

*KROK 2:* V případě nutnosti lze roztok tekutého čisticího prostředku a vody nanést štětcem s měkkými štětinami. Setřete zbytky hadříkem navlhčeným ve vodě.

## OBTÍŽNĚ ODSTRANITELNÉ ZAŠPINĚNÍ

*KROK 1:* Navlhčete měkký bílý hadřík do roztoku domácího bělidla (chlornan sodný) smíchaného s vodou v poměru 10:90.

*KROK 2:* Jemně otřete.

*KROK 3:* Otřete hadříkem navlhčeným ve vodě, abyste odstranili bělidlo.

*KROK 4:* V případě potřeby nechte na postižené oblasti působit zředěný roztok bělidla v poměru 1:10 nebo nanášejte čistým, namočeným hadříkem po dobu přibližně 30 minut. Otřete hadříkem navlhčeným ve vodě, abyste odstranili zbývající bělidlo.

## OBNOVA LESKU

Abyste obnovili lesk, lze použít jemnou vrstvu spreje s voskem na nábytek. Naneste na 30 sekund a poté lehce leštěte čistým bílým hadříkem.

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Tyto informace neslouží jako záruka. Všechny čisticí a dezinfekční přípravky používejte podle návodu výrobce. Použití jiných čisticích prostředků, dezinfekčních prostředků, změkčovačů nebo ochranných prostředků se nedoporučuje a může zhoršit vzhled a funkčnost látky a zrušit záruku na čalounění.*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Různé oděvy a doplňky mohou obsahovat barviva, která se mohou v závislosti na změnách teploty a vlhkosti přenášet na světlejší barvy. Přenos barev je obtížné kontrolovat, nelze mu vždy zcela zabránit a může být nevratný. Tkanina nemusí chránit před neúmyslnými skvrnami nebo trvalými inkousty.*

*DTE OREGON, INC.* *DENTALEZ.COM*

*6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715*

CE

Symboly, pojmy, prohlášení o EMC/elektrické bezpečnosti a pokyny pro uživatele naleznete v obecné provozní příručce Forest™.

*INDIKACE PRO POUŽITÍ / ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ* Zubařské křeslo je mechanické sedadlo určené k polohování zubních pacientů pro lepší přístup a viditelnost do dutiny ústní pro zubního lékaře během diagnostického a terapeutického ošetření v klinickém prostředí. Tento produkt nemá žádné kontraindikace.

*ZAMÝŠLENÁ POPULACE PACIENTŮ* Neexistují žádná omezení populace pacientů, kteří mohou být léčeni zařízeními značky Forest.

*OČEKÁVANÁ ŽIVOTNOST* Při řádné údržbě a servisu mají produkty Forest při normálním používání definovanou „životnost" (vychází z počtu přibližně 50 pacientů týdně) 5 let od data výroby, s výjimkou servisovatelných součástí. Některé komponenty se mohou stát zastaralými kvůli změnám v technologii nebo vylepšení produktů a mohou vyžadovat vylepšení nebo modernizaci. Na konci definovaného servisního života je nutné, aby byly všechny produkty před dalším používáním přezkoumány vyškoleným servisním technikem. Poté jsou další přezkoumání vyžadovány každých 5 let.

*VAROVÁNÍ: Aby se předešlo možnému zranění způsobenému náhodným použitím, nenechávejte malé děti bez dozoru.*

*VAROVÁNÍ: V podlahovém boxu se nenachází žádné díly, jejichž servis může provádět uživatel. Ke komponentám síťového napětí v základně křesla by měli přistupovat pouze autorizovaní a vyškolení odborníci.*

*VAROVÁNÍ: Před výměnou spálených pojistek vypněte křeslo a odpojte napájecí kabel. Náhradní pojistky se pro vaše pohodlí nachází v krytu čerpadla.*

*UPOZORNĚNÍ: Federální zákony omezují prodej tohoto zařízení stomatologům nebo na jejich objednávku, kteří mají licenci podle zákona státu, ve kterém používají nebo objednávají použití zařízení.*

*UPOZORNĚNÍ: Než se křeslo pokusíte přesunout, je nutné jej snížit do nejnižší pozice a uzamknout v rotaci nula stupňů. Důrazně se doporučuje, aby příslušenství, jako jsou světla a jednotky, bylo před stěhováním odstraněno.*

*POZNÁMKA: Kompletní technické pokyny naleznete v servisní příručce a návodu k instalaci.*



## *TECHNICKÝ POPIS / SPECIFIKACE*

| | |
|---|---|
| Vstupní napětí | 115 VAC / 230 VAC 50/60 Hz |
| Řídicí napětí | 5 VDC |
| Pojistky | 115 VAC F1/F2 -10 A, F3-125 mA |
| | 230 VAC F1/F2 - 6,3 A, F3-63 mA |
| Pracovní cyklus | 5 % (přerušovaný 25 s zapnuto, 300 s |
| vypnuto) | |

Ochrana proti elektrickým nebezpečím zařízení třídy 1, typ B
Maximální hmotnost pacienta 136 kg
Kapacita podacího systému 57 kg
Celková kapacita zvedání 225 kg
Úroveň hluku <40 dB

## *UMÍSTĚNÍ KLOUBOVÉ OPĚRKY HLAVY*

Správné umístění kloubové opěrky hlavy tak, aby podpírala hlavu v přirozeném vztahu k páteři, snižuje napětí v šíjových a čelistních svalech a snižuje požadavek na „širší otevření, prosím".

*KROK 1:* Ve vzpřímené poloze úplně stiskněte uvolňovací mechanismus vpravo a nastavte opěrku hlavy tak, aby odpovídala výšce pacienta (OBR. 1).

*KROK 2:* Nakloňte vycpání opěrky hlavy, aby se dotýkalo zadní části pacientovy hlavy.

*KROK 3:* Sklopte pacienta. V případě nutnosti upravte pozici opěrky hlavy s pomocí uvolňovacího mechanismu (OBR. 2).

*POZNÁMKA: Aby se předešlo zašpinění opěrky hlavy, doporučuje se použití jednorázových pokrývek opěrky hlavy.*

*OBR. 1: VZPŘÍMENĚ*

*OBR. 2: SKLOPENÍ*

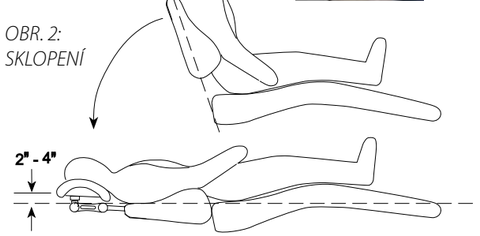


## *POLOHOVÁNÍ OPĚRKY HLAVY PRO INVALIDNÍ VOZÍK*

*VAROVÁNÍ: Před umístěním hlavy pacienta na opěrku hlavy se ujistěte, že jsou zajištěny zámky kol invalidního vozíku.*

Opěrku hlavy lze použít u pacientů na invalidním vozíku.

*KROK 1:* Posuňteopěrku hlavy nahoru, dokud se neuvolní z křesla. Otočte opěrku hlavy o 180°.

*KROK 2:* Nasuňte otočenou opěrku hlavy zpět do opěradla a zatlačte ji úplně dolů.

*KROK 3:* Nastavte křeslo do zcela vzpřímené polohy. Nastavte výšku opěrky hlavy posunutím křesla nahoru či dolů (pomocí funkce zvednutí základny na nožním ovládání nebo touchpadu).

*KROK 4:* Umístěte pacienta. V případě potřeby upravte pozici opěrky hlavy (OBR. 3).

## *OTÁČENÍ KŘESLA*

*KROK 1:* Chcete-li křeslem otáčet, odemkněte brzdu křesla pohybem madla brzdy v zadní části křesla směrem doparava (OBR. 4).

*KROK 2:* Otočte křeslo do požadované pozice.

*KROK 3:* Zamkněte brzdu křesla pohybem madla brzdy v zadní části křesla směrem doleva.

## *NOŽNÍ OVLÁDÁNÍ A OVLÁDÁNÍ TOUCHPADU (OBR. 5 A 6)*

*UPOZORNĚNÍ: Abyste zabránili přestříkání nečistot z předčasně stárnoucích elektronických součástek.*

*POZNÁMKA: Časté předvolby: 1, 2 a 3 pro provozní pozice a 4 pro odchod pacienta.*

## *RUČNÍ POLOHOVÁNÍ:*

*KROK 1:* Vyberte směr pojezdu (základna nahoru; základna dolů; zpět nahoru; zpět dolů)

*KROK 2:* Abyste posunuli křeslo do továrně nastaveného limitu pojezdu, stiskněte a uvolněte odpovídající tlačítko.

*POZNÁMKA: Podržením směrového tlačítka se křeslo posouvá, dokud není tlačítko uvolněno.*

## *PROGRAMOVÁNÍ A PŘEPROGRAMOVÁNÍ AUTOMATICKÝCH POZIC.*

*KROK 1:* Pomocí ručního ovládání touchpadu nastavte křeslo do požadované pozice.

*KROK 2:* Krátce stiskněte tlačítko programu (OBR. 7), křeslo dvakrát zapípá, čímž naznačí, že je připraveno přiřadit tuto pozici automatickému tlačítku.

*KROK 3:* Pro přiřazení této pozice stiskněte automatické tlačítko. Křeslo třikrát zapípá, čímž naznačí, že program je dokončen.

*KROK 4:* Selhání programu značí to, že křeslo zapípá více než třikrát.

*KROK 5:* Abyste naprogramovali zbývající automatická tlačítka, opakujte kroky 1–3.

*POZNÁMKA: Přeprogramování nové automatické pozice vymaže starou pozici.*

## *AKTIVE AUTOMATICKÝCH POZIC*

*KROK 1:* Stisknutím automatického tlačítka 1, 2, 3 nebo 4, jakmile na nožní ovládání nebo touchpadu.

*KROK 2:* Ozve se pípnutí.

*KROK 3:* Křeslo se automaticky zastaví ve vybrané naprogramované pozici.

*POZNÁMKA: Stisknutí libovolného tlačítka na ovladači křesla, když se křeslo pohybuje do naprogramované polohy, okamžitě zastaví pohyb křesla a zazní tři krátká pípnutí. Chcete-li pokračovat a dokončit automatické polohování křesla, jednoduše podruhé stiskněte tlačítko požadované pozice.*

*OBR. 3: POLOHOVÁNÍ OPĚRKY HLAVY PRO INVALIDNÍ VOZÍK*

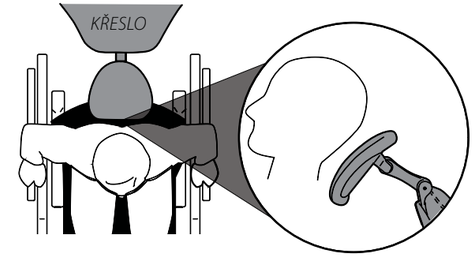


*OBR. 4: OTAČENÍ KŘESLA*

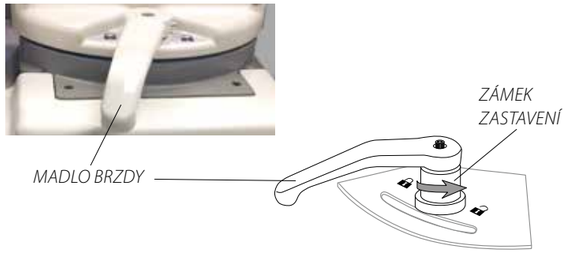


*OBR. 5: NOŽNÍ OVLÁDÁNÍ*

*OBR. 6: OVLÁDÁNÍ TOUCHPADU*

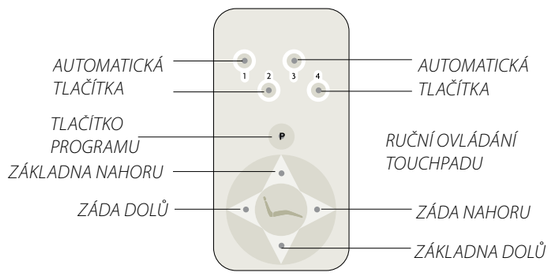


*OBR. 7: TLAČÍTKO PROGRAMU*