Forest DENTALEZ

KÄSINOJA

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Mahdollisten potilasvahinkojen minimoimiseksi tuolin käsinojat liikkuvat, mikä helpottaa tuoliin ja tuolista astumista. Muista laskea käsinoja potilaan nousua/laskeutumista helpottaaksesi ennen toimenpidettä ja sen jälkeen. Käsinojia ei ole suunniteltu kestämään potilaan painoa hänen noustessaan tuoliin tai siitä pois.*

VAIHE 1: Laske käsinoja vetämällä ylös käsinojan vipua, joka sijaitsee käsinojarakenteen takaosassa (KUVA 8).

VAIHE 2: Nosta käsinoja nostamalla käsinojan laskettua päätä, kunnes käsinoja pysähtyy ja naksahtaa lukittuun asentoon.

KUVA 8: KÄSINOJAN VIPU

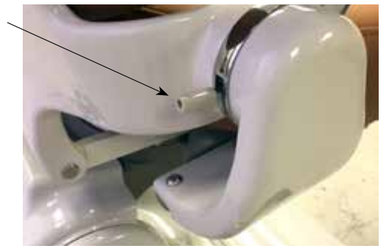

NISKATUEN LIUKUKIRISTYKSEN SÄÄTÖ

VAIHE 1: Poista selkänojan tyyny (KUVA 9).

VAIHE 2: Säädä ruuveja (KUVA 10).

VAIHE 3: Palauta selkänojan tyyny (KUVA 11).

TARVITTAVAT TYÖKALUT: Ristipääruuvitaltta

KUVA 9: SELKÄNOJA



KUVA 10: RUUVIT



KUVA 11: TYYNY

VERHOILUN YLLÄPITO

⚠ *VAROITUS: Lue aina desinfiointiaineen valmistajan ohjeet ja varmista, että liuos ei ole vaaraksi ihmisille tai aineille, joihin se koskee. Lisätietoja ympäröivien pintojen puhdistuksesta ja desinfioinnista löytyy Forest™:n Hoitolaitteiston aseptiikka – käyttäjän oppaasta. Muita infektionhallintaan liittyviä tietolähteitä:*

ohjeita infektionhallintaan hammashuoltoyhteyksissä: www.cdc.gov

Yhdysvaltain hammaslääkäriyhdistyksen suositukset: www.ada.org

Turvallisuus- ja aseptiikkakäytäntöorganisaation suositukset: www.osap.org

⚠ *VAROITUS: Noudata kaikkia valmistajan varoituksia. Forestia tai verhoilun valmistajaa ei voi asettaa vastuuseen puhdistustuotteiden käytöstä tai väärinkäytöstä aiheutuvista vahingoista tai vammoista. Puhdistusaineet saattavat sisältää voimakkaita tai tuntemattomia liuotteita, ja niiden valmistaja saattaa muuttaa kaavaa siitä ilmoittamatta. Jos käytät muita kuin kuvattuja puhdistusaineita, suosittelemme vahvasti niiden kokeilua ensin vähemmän näkyvällä pinnalla ja sen varmistamista, että ne eivät vahingoita verhoilua eivätkä muovi- tai metallipintoja.*

Oikeaoppinen ylläpito ja säännöllinen puhdistaminen estävät lian liiallisen kertymisen. Pidennä Naugahyde®-kankaan käyttöikää ja pidä laatukankaat hyvännäköisinä näillä ohjeilla.

KEVYT LIKAANTUMINEN

VAIHE 1: Useammat likatyypit saa pois liuoksella, jossa on lämmintä vettä ja 10 % mietoa saippuaa. Pyyhi pehmeällä ja kostealla liinalla.

VAIHE 2: Tarvittaessa voit levittää veteen laimennettua nestemäistä puhdistusainetta pehmeällä harjalla. Pyyhi jäännökset vedellä kostutetulla liinalla.

HANKALAMMAT TAHRAT

VAIHE 1: Kostuta pehmeä valkoinen liina liuoksella, jossa on 10 % valkaisuainetta kotitalouskäyttöön (natriumhypokloriittia) ja 90 % vettä.

VAIHE 2: Hiero kevyesti.

VAIHE 3: Pyyhi valkaisuainekertymät vedellä kostutetulla liinalla.

VAIHE 4: Anna laimennetun valkaisuaineliuoksen (1:10) vaikuttaa tarvittaessa likaisella alueella tai levitä liuosta siihen upotetulla puhtaalla liinalla noin 30 minuuttia. Pyyhi mahdolliset valkaisuainekertymät vedellä kostutetulla liinalla.

KIILLON PALAUTTAMINEN

Kiillon palauttamiseksi voit suihkuttaa ohuen kerroksen kalustevahaa. Levitä 30 sekuntia ja kiillota kevyesti puhtaalla valkoisella liinalla.

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Nämä tiedot eivät ole takuu. Käytä kaikkia puhdistus- ja desinfiointiaineita turvallisesti ja valmistajan ohjeita noudattaen. Emme suosittele muiden puhdistus-, desinfiointi-, hoito- tai suoja-aineiden käyttöä. Ne voivat heikentää kankaan suorituskykyä ja mitätöidä verhoilun takuun.*

⚠ *TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Monenlaisissa vaatteissa ja asusteissa saattaa olla väriaineita, jotka voivat mahdollisesti siirtyä vaaleampiin väreihin lämpötilan ja kosteuden muutoksista riippuen. Värin siirtyminen on vaikeasti hallittavaa, hankalasti ehkäistävää ja mahdollisesti pysyvää. Kangas ei välttämättä suojele tahattomilta tahroilta tai kestomusteilta.*

DTE OREGON, INC. DENTALEZ.COM

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE

Katso symbolien selitykset, käyttöehdot, sähkömagneettista yhteensopivuutta / sähköturvallisuutta koskeva vakuutus ja käyttäjän ohjeet yleisestä Forest™:n käyttäjän oppaasta.

KÄYTTÖAIHEET/KÄYTTÖTARKOITUS Potilastuoli on mekaaninen istuin, jolla on tarkoitus parantaa potilaan suuontelon näkyvyyttä ja hammaslääkärin ulottuvuutta suuonteloon potilaan asentoa muokkaamalla diagnosoitaessa ja hoidettaessa kliinisessä ympäristössä. Tuotteelle ei ole vasta-aiheita.

SUUNNITELTU POTILASPOPULAATIO Forest-laitteilla hoidettavalle potilaspopulaatiolle ei ole rajoituksia.

ODOTETTU KÄYTTÖIKÄ Oikein ylläpidettyinä ja huollettuina Forest-tuotteet on suunniteltu kestämään tavallisessa käytössä (perustuen noin 50 potilaaseen viikossa) viiden vuoden ajan valmistuspäivästä, huollettavat osat pois lukien. Tietyt osat saattavat vanhentua teknologian muuttuessa tai tuotteiden parantuessa, mikä saattaa aiheuttaa tuotteen päivitystarpeen. Odotetun käyttöiän lopussa kaikki tuotteet on luovutettava koulutetun huoltoteknikon tarkastettavaksi ennen käytön jatkamista. Sen jälkeen tuotteet on tarkastettava viiden vuoden välein.

VAROITUS: Älä jätä pieniä lapsia valvomatta, tuolin tahaton käyttö saattaa aiheuttaa vammoja.

VAROITUS: Lattialaatikossa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Vain koulutetut ja pätevät ammattilaiset saavat käsitellä tuolin alustan sähköverkkokomponentteja.

VAROITUS: Sammuta tuoli ja irrota virtajohto ennen palaneiden sulakkeiden vaihtamista. Pumpun kannessa on käytännöllisyyden vuoksi lisäsulakkeita.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Yhdysvaltain lain mukaan tätä välinettä saa myydä pätevä hammaslääkäri vain siinä Yhdysvaltain osavaltiossa, jossa hän toimii ja käyttää laitetta tai jossa hän tilaa laitteen, tai muu henkilö hammaslääkärin määräyksestä.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Ennen tuolin siirtämistä tuoli on laskettava täyteen ala-asentoon ja lukittava paikalleen nollan asteen kierrossa. Suosittelemme vahvasti lisävälineiden, esim. valojen ja muiden yksikköjen, poistamista ennen siirtämistä.

HUOMIO: Katso täydelliset tekniset kuvaukset huolto- ja asennusohjeista.

TEKNINEN KUVAUS / TEKNISET TIEDOT

Tulojännite	115 VAC / 230 VAC 50/60 Hz
Ohjausjännite	5 VDC
Sulakkeet	115 VAC F1/F2 – 10 A, F3 – 125 mA 230 VAC F1/F2 – 6,3 A, F3 – 63 mA
Käyttöjakso	5 % (katkonainen 25 s päällä, 300 s pois päältä)
Sähkösuojaluokitus	Luokan 1 laite, tyyppi B
Potilaan enimmäispaino	300 lbs (136 kg)
Hoitojärjestelmän kantokyky	125 lbs (57 kg)
Nostimen kokonaiskantokyky	450 lbs (225 kg)
Melutaso	< 40 dB

NIVELNISKATUEN ASETTELU

Nivelniskatuen oikeaoppinen asettelu niin, että se tukee päätä luonnollisessa suhteessa selkärankaan vähentää niska- ja puremalihasten jännitystä, mikä tarkoittaa vähentynyttä tarvetta kehottaa potilasta avaamaan suuta leveämmäksi.

VAIHE 1: Kun tuoli on täydessä yläasennossa, paina vapautusmekanismi oikealla pohjaan ja säädä niskatuki potilaan pituuteen sopivaksi. (KUVA 1).

VAIHE 2: Käännä niskatuen tyyny hyvin kosketuksiin potilaan takaraivon kanssa.

VAIHE 3: Aseta potilas makuulle. Hienosäädä niskatuen asentoa tarvittaessa vapautusmekanismilla (KUVA 2).

HUOMIO: Niskatuen likaantumisen estämiseksi suosittelemme kertakäyttöisiä niskatuen peitteitä.

KUVA 1: PYSTYSSÄ

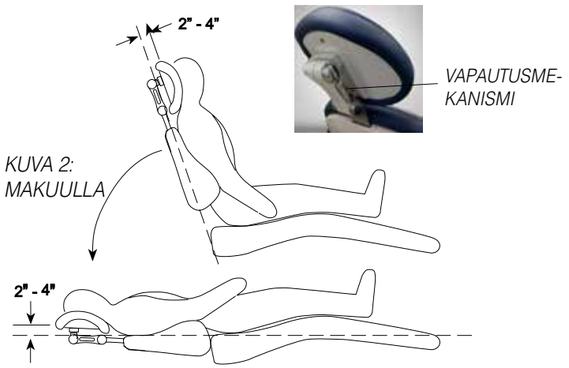

NISKATUEN SIJOITUS PYÖRÄTUOLIN KANSSA

VAROITUS: Varmista, että pyörätuolin pyörät on lukittu ennen potilaan pään asettamista niskatukeen.

Niskatuen voi säätää mukavaksi pyörätuolia käyttäville potilaille.

VAIHE 1: Liu'uta niskatukea ylös, kunnes se on irti tuolista. Käännä niskatukea 180°.

VAIHE 2: Liu'uta käännetty niskatuki takaisin selkänojaan ja työnnä alas asti.

VAIHE 3: Aja tuolin selkänoja täyteen yläasentoon. Säädä niskatuen korkeutta siirtämällä tuolia ylös tai alas (polkimen tai kosketuspaneelin Alusta ylös -toiminnolla).

VAIHE 4: Asettele potilas. Hienosäädä niskatuen asentoa tarvittaessa (KUVA 3).

TUOLIN KÄÄNTÄMINEN

VAIHE 1: Avaa tuolin jarru kääntämällä jarrukahvaa tuolin selässä oikealle, jos haluat kääntää tuolia (KUVA 4).

VAIHE 2: Käännä tuoli haluttuun asentoon.

VAIHE 3: Lukitse tuolin jarru kääntämällä jarrukahvaa tuolin selässä vasemmalle.

JALKAKÄYNNISTIN JA KOSKETUSPANEELIOHJAIN (KUVAT 5 JA 6)

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Estä ruiskutussumun epäpuhtauksia aiheuttamasta elektroniikan komponenttien ennenaikaista vanhentumista suojuksella.

HUOMIO: Yleiset esiasetukset: 1,2 ja 3 hoitoasennot, 4 potilaan poistuminen.

MANUAALINEN SIJOITTELU

VAIHE 1: Valitse kulkusuunta (alusta ylös, alusta alas, selkä ylös, selkä alas).

VAIHE 2: Siirrä tuoli tehtaalla asetettuun kulkurajaan painamalla kutakin painiketta.

HUOMIO: Suuntapainikkeen pitäminen painettuna siirtää tuolia siihen asti, että painike vapautuu.

AUTOMAATTIASENTOJEN OHJELMOIMINEN JA MUUTTAMINEN

VAIHE 1: Siirrä tuoli haluttuun asentoon manuaalisilla kosketuspaneelin ohjaimilla.

VAIHE 2: Paina ohjelmointipainiketta lyhyesti (KUVA 7), niin tuoli piippaa kahdesti ja asento on valmis määritettäväksi automaattipainikkeeseen.

VAIHE 3: Määritä asento automaattipainikkeeseen painamalla automaattipainiketta. Tuoli piippaa kolmesti, ja ohjelmointi on valmis.

VAIHE 4: Jos tuoli piippaa yli kolme kertaa, ohjelmointi epäonnistui.

VAIHE 5: Ohjelmoi loput automaattipainikkeet toistamalla vaiheet 1–3.

HUOMIO: Uuden automaattiasennon ohjelmointi pyyhkii vanhan asennon muistista.

AUTOMAATTIASENTOJEN AKTIVOINTI

VAIHE 1: Paina jalkakäynnistimen tai kosketuspaneeliohjaimen automaattipainiketta 1, 2, 3 tai 4 kerran.

VAIHE 2: Kuulet merkkiäänen.

VAIHE 3: Tuoli pysähtyy automaattisesti valittuun ohjelmoituun asentoon.

HUOMIO: Minkä tahansa painikkeen painaminen tuolin siirtyessä ohjelmoituun asentoon pysäyttää liikkeen välittömästi, mistä kuuluu merkiksi kolme lyhyttä piippausta. Jos haluat jatkaa tuolin siirtämistä, paina haluttua asentopainiketta toisen kerran.

KUVA 3: NISKATUEN SIJOITUS PYÖRÄTUOLIN KANSSA

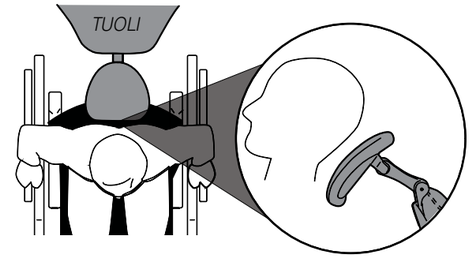

KUVA 4: TUOLIN KÄÄNTÄMINEN

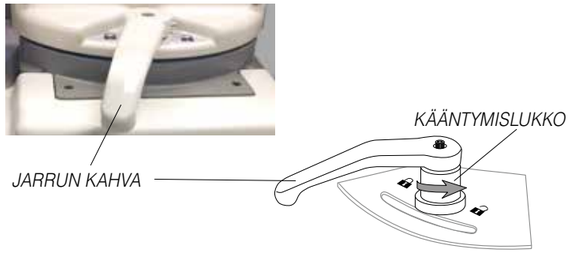

KUVA 5: JALKAKÄYNNISTIMEN OHJAIMET

KUVA 6: KOSKETUSPANEELIN OHJAIMET

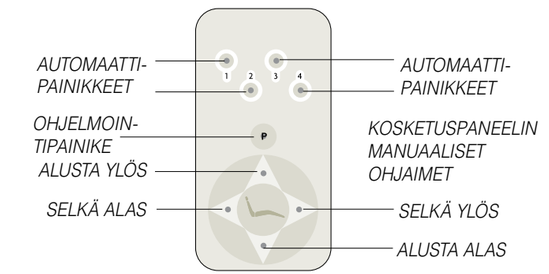

KUVA 7: OHJELMOINTIPAINIKE