Forest

DENTALEZ

Veškeré ovládání se nachází na předním panelu.

AUTOMATICKÉ OVLÁDÁNÍ NÁSADCE

HLAVNÍ ZAP./VYP. (OBR. 1).

Zapne vzduch a vodu pro celý systém. Tento přepínač ovládá hlavní ventily poháněné vzduchem v utility centru. Systém aktivujete přepnutím přepínače doprava (zapnuto). Kdykoli se jednotka nepoužívá, vždy přepněte přepínač doleva (vypnuto).

MĚŘIČ TLAKU NÁSADCE (NACHÁZÍ SE UVNITŘ OVLÁDACÍ HLAVY)

Ukazuje tlak vzduchu pohonu násadce.

NASTAVENÍ TLAKU VZDUCHU POHONU (OBR. 2).

Umožňuje nastavení násadce na provozní tlak doporučený výrobcem. Otočením nastavovacího šroubu ve směru hodinových ručiček tlak zvýšíte, otočením ve směru hodinových ručiček tlak snížíte.

NASTAVENÍ PRŮTOKU CHLADICÍ VODY (OBR. 3).

Umožňuje nastavení chladicí vody jednotlivých násadců. Abyste zvýšili průtok, otočte knoflík proti směru hodinových. Abyste snížili průtok, otočte knoflík ve směru hodinových ručiček.

PROPLÁCHNUTÍ NÁSADCE (OBR. 4).

Propláchne vedení vody násadce dentální jednotky.

⚠ *VAROVÁNÍ: Podrobné pokyny k údržbě vedení vody dentální jednotky stříkačky naleznete v provozní příručce údržby vedení vody dentální jednotky Forest™.*

ŘÍZENÍ PRŮTOKU CHLADICÍ VODY (OBR. 5).

Umožňuje nastavení násadců. Abyste zvýšili průtok, otočte knoflík proti směru hodinových. Abyste snížili průtok, otočte knoflík ve směru hodinových ručiček.

CHLADICÍ VODA ZAP./VYP. (NACHÁZÍ SE NA NOŽNÍ OVLÁDÁNÍ)

Aktivujte systém chladicí vody násadce. Abyste zapnuli chladicí vodu, přepněte přepínač k červené tečce.

PNEUMATICKÁ BRZDA (OBR. 6).

Aktivujte brzdu ohebného ramene. Tlačítko se nachází na rukojeti ovládací hlavy Brzdu uvolníte stisknutím tlačítka.

ODSTRANĚNÍ VÍKA (OBR. 7)

Když se víko nachází přímo před vámi:

KROK 1: Roztáhněte levou a pravou stranu víko směrem ven a nahoru.

KROK 2: Levou rukou znovu umístěte ramena s násadci dopředu.

KROK 3: Chytněte zadní stranu (střed) víka a vytáhněte pravou rukou.

POZNÁMKA: Sada nástrojů pro externí nastavení se nachází uvnitř ovládací hlavy.

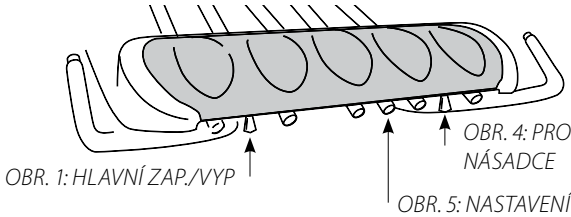

OBR. 1: HLAVNÍ ZAP./VYP

OBR. 4: PROPLÁCHNUTÍ NÁSADCE

OBR. 5: NASTAVENÍ PRŮTOKU CHLADICÍHO VZDUCHU

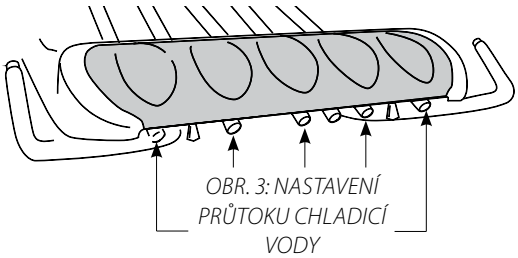

OBR. 3: NASTAVENÍ PRŮTOKU CHLADICÍ VODY

(ZAROVNEJTE S RAMENY S NÁSADCI ZLEVA DOPRAVA 1, 2, 3, 4, 5)

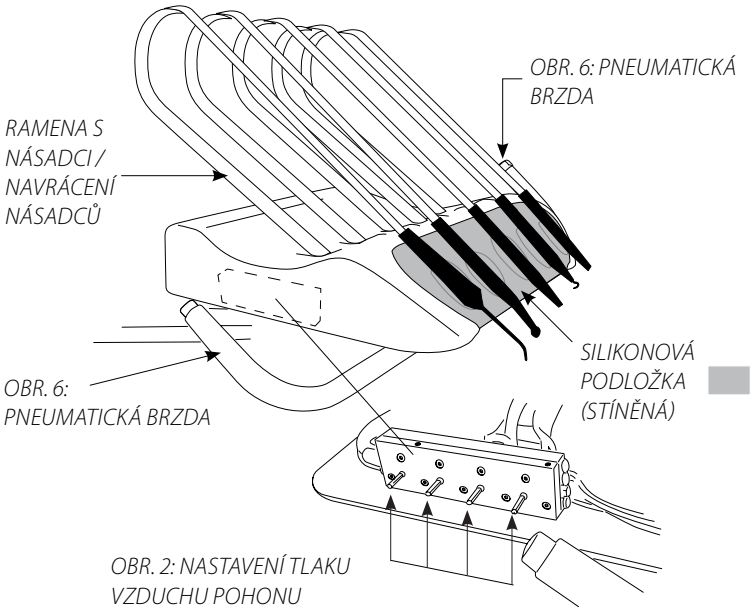

OBR. 6: PNEUMATICKÁ BRZDA

RAMENA S NÁSADCI / NAVRÁCENÍ NÁSADCŮ

OBR. 6: PNEUMATICKÁ BRZDA

SILIKONOVÁ PODLOŽKA (STÍNĚNÁ)

OBR. 2: NASTAVENÍ TLAKU VZDUCHU POHONU

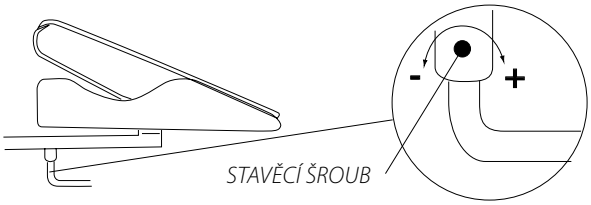

STAVĚCÍ ŠROUB

OBR. 7:

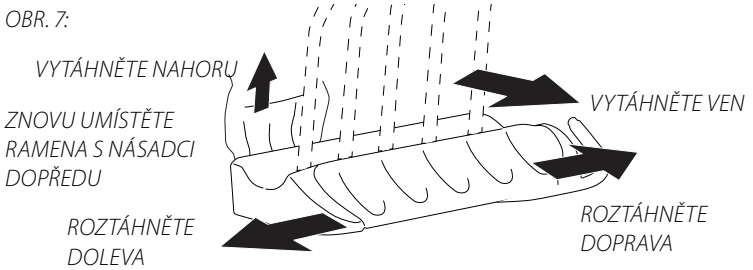

VYTÁHNĚTE NAHORU

VYTÁHNĚTE VEN

ZNOVU UMÍSTĚTE RAMENA S NÁSADCI DOPŘEDU

ROZTÁHNĚTE DOLEVA

ROZTÁHNĚTE DOPRAVA

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE 0459