DRŽÁK MONITORU

Forest

DENTALEZ

PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

Symboly, pojmy, prohlášení o EMC / elektrické bezpečnosti a pokyny pro uživatele naleznete v obecné provozní příručce Forest™.

INDIKACE PRO POUŽITÍ / ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ Držák monitoru je montážní základna pro obrazovku monitoru, který má zvětšit nebo vizualizovat dutinu ústní, aby měl stomatolog lepší přehled o pacientovi, když během diagnostického a terapeutického ošetření v klinickém prostředí používá nitroústní kameru. Tento produkt nemá žádné kontraindikace.

OČEKÁVANÁ ŽIVOTNOST Při řádné údržbě a provádění servisu mají produkty Forest při normálním používání definovanou „životnost" (vychází z počtu přibližně 50 pacientů týdně) 5 let od data výroby, s výjimkou servisovatelných součástí. Některé komponenty se mohou stát zastaralými kvůli změnám v technologii nebo vylepšení produktů a mohou vyžadovat vylepšení nebo modernizaci. Na konci definovaného servisního života je nutné, aby byly všechny produkty před dalším používáním přezkoumány vyškoleným servisním technikem. Poté jsou další přezkoumání vyžadovány každých 5 let.

⚠ *VAROVÁNÍ: Monitor (rovný panel) se musí vejít na desku VESA 100 x 100 a nesmí přesahovat: Hmotnost: 15 lbs (6,81 kg) Celková velikost úhlopříčky: 24" (61,96 cm).*

⚠ *UPOZORNĚNÍ: Federální zákony omezují prodej tohoto zařízení stomatologům nebo na jejich objednávku, kteří mají licenci podle zákona státu, ve kterém používají nebo objednávají použití zařízení.*

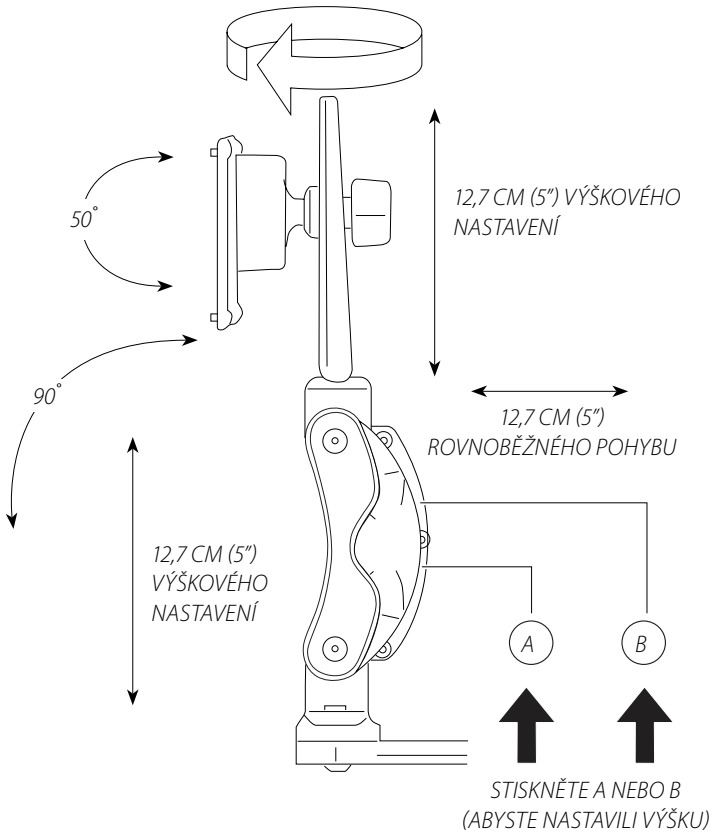

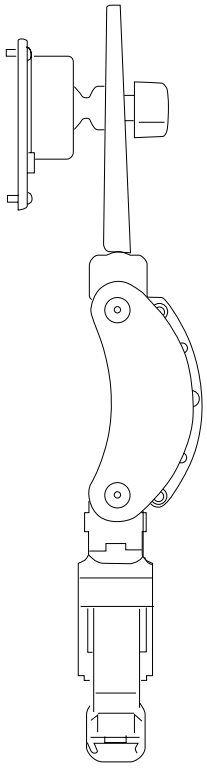

DTE OREGON, INC. *DENTALEZ.COM*

6200 NE Cherry Drive, Hillsboro, OR 97124 USA (TF) 800 . 423 . 3555 (T) 503 . 640 . 3012 (F) 503 . 693 . 9715

CE